



# Nanoleaf LED Light Therapy Face Mask


**CZ** Stručný průvodce




## Obsah balení




Ochranné kryty očí (1 pár)




LED světelná maska na obličej



Ovladač




Nabíjecí kabel (USB A na USB C)



Suchý zip (1 pár)

# Ovládání

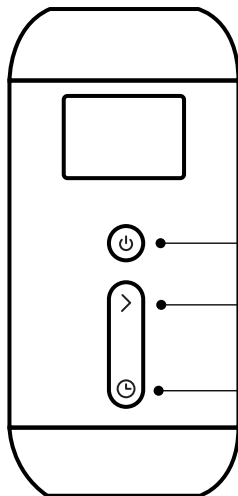

## Zapínání

Vaše zariadenie je predvolene nastavené na automatické vypnutie po 10 minútach. Počas používania stlačte tlačidlo zapínání ešte raz pre pozastavenie časovača.

## Výber režimu

Podržte tlačidlo na 2 sekundy pre zapnutie/vypnutie.

Každý svetelný režim je kombinovaný s blízky infračerveným svetlom (NIR) na zlepšenie účinnosti ošetrovania. Na obrazovke sa zobrazí príslušný svetelný režim. Rýchlym dvojitém stlačením môžete prepínať medzi 5 úrovňami intenzity.

## Časovač

Obrazovka zobrazí príslušnú intenzitu svetla. Stlačením tlačidla prepínate medzi terapiou červeným, zeleným, modrým, fialovým, tyrkysovým, žltým a bielym svetlom. Stlačením tlačidla pridáte 1 minútu k časovaču. Dlhým stlačením môžete rýchlo pridať viac minút, až do maximálnej hodnoty 30 minút. Po uplynutí nastaveného času sa zariadenie automaticky vypne.

# Režimy světelné terapie

Každý světelný režim je kombinován s blízkým infračerveným světlem (NIR) s průnikem 850 nm, které zlepšuje účinnost ošetření.

## ● Režim červeného světla (640 nm + 850 nm) Mód R

Zvyšuje aktivitu buněk a podporuje tvorbu kolagenu, čímž zlepšuje pružnost pokožky a snižuje výskyt vrásek.

## ● Modré světlo (460nm + 850nm) Mód B

Antibakteriální a protizánětlivé, které pomáhá redukovat výskyty akné a obnovovat pokožku.

## ● Režim zeleného světla (525 nm + 850 nm) Mód G

Zvyšuje stimulaci buněčné energie, čímž pomáhá vyrovnávat tón pleti, redukovat zarudnutí a hyperpigmentaci.

## ● Režim azurového světla (460nm + 525nm + 850nm) Mód C

Zklidňuje a zklidňuje namáhanou pokožku. Podporuje hojení a léčí záněty.


# Režimy světelné terapie

Každý světelný režim je kombinován s blízkým infračerveným světlem (NIR) s průnikem 850 nm, které zlepšuje účinnost ošetření.

-  **Žluté světlo (640nm + 525nm + 850nm)**  
**Mód Y**  
Podporuje hojení tkání a pomáhá léčit růžovku, snižuje zarudnutí a zlepšuje celkový tón pleti.
-  **Bílé světlo (640nm + 525nm + 460nm + 850nm)**  
**Mód L**  
Proniká do hloubky pokožky, aby urychlilo metabolismus pokožky a zlepšilo vstřebávání živin.
-  **Fialové světlo (640nm + 460nm + 850nm)**  
**Mód P**  
Vícefrekvenční ošetření zaměřené na akné a jizvy po akné.

## Jak nainstalovat oční důlky

Opatrně vložte oční důlky zevnitř.

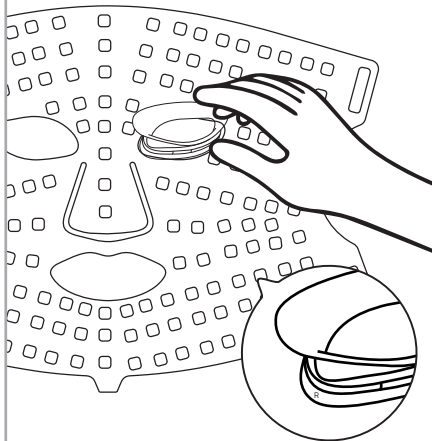


✓  
Správně




✗  
Špatně

## Jak připevnit řemínky

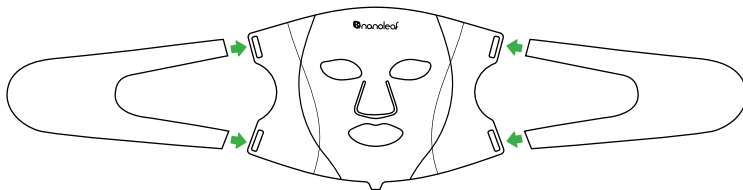

Vložte popruhy a utáhněte je pomocí suchého zipu.

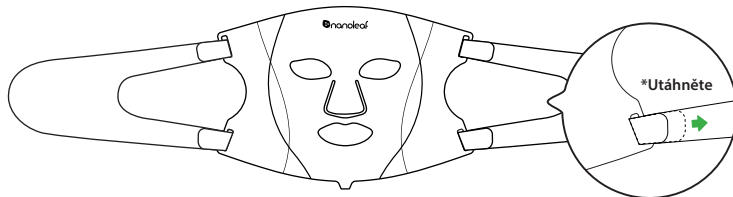


## Důležité informace




### UPOZORNĚNÍ

Nejedná se o zdravotnický prostředek a nelze jej používat k odborné léčbě nebo jako náhradu za odborné lékařské poradenství. Skutečný účinek použití se u jednotlivých osob liší.



Nepoužívejte zařízení během nabíjení.

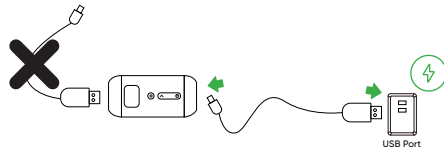


Pokud se zařízení během nabíjení nadměrně zahřívá, vydává kouř nebo vydává neobvyklý zápach, okamžitě odpojte nabíječku a kontaktujte zákaznický servis.

# Důležité informace


## Nabíjení

3,5 hodiny pro plné nabití

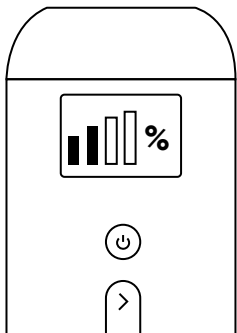

## Přenášení



Tento výrobek je dobíjecí a přenosný a během používání nemusí být připojen ke zdroji napájení.

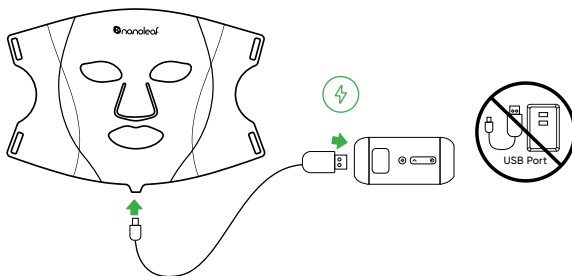



## Bezpečnostní opatření

Během používání je ideální mít zavřené oči. Je to skvělý čas na relaxaci!

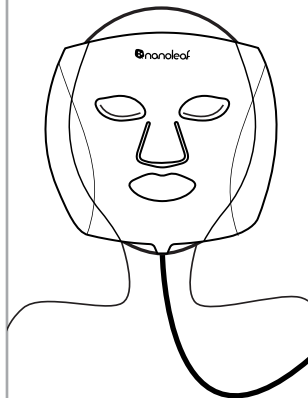

Nedívejte se přímo na světla LED.

**Nedělejte**



Neohýbejte




Nemačkejte




Nestlačujte

Při čištění masky ji nenamáčejte do vody.



Při čištění masky ji nenamáčejte do vody, ale otřete ji vlhkým hadříkem nebo 70% alkoholem.



annuler la garantie. Des méthodes appropriées d'élimination et de recyclage des batteries usagées doivent être suivies. Référez-vous toujours aux directives du fabricant pour l'entretien et la gestion des batteries. 2. Ne laissez pas la batterie de votre appareil inutilisée pendant de longues périodes. Pour maintenir une bonne santé de la batterie, chargez-la au moins une fois tous les trois mois. 3. Pour préserver la durée de vie de la batterie, assurez-vous de la charger peu de temps après utilisation. Une décharge excessive peut affecter les performances de la batterie. 4. Évitez le stockage à long terme de l'appareil avec une batterie déchargée. Chargez la batterie à au moins 50 % avant de la stocker pendant une période prolongée afin de prévenir tout dommage permanent.

**INFORMATION CE** NanoGrid Limited (Nanoleaf) déclare par la présente que cet appareil est conforme aux exigences essentielles et aux autres dispositions pertinentes de la directive 2014/53/UE. La déclaration de conformité est disponible sur <https://nanoleaf.me/eudocs>. **NETTOYAGE ET ENTRETIEN** - Ne nettoyez pas l'appareil avec des liquides ou des sprays lorsqu'il est branché. Nettoyez avec un chiffon doux et sec, et n'utilisez pas de produits de nettoyage agressifs.

**GARANTIE** Ce produit est couvert par une garantie d'un an à compter de la date d'achat. Les dommages dus à l'usure et au temps ne sont pas couverts par la garantie de service. La garantie de ce produit n'inclut pas les défaillances causées par des facteurs autres que des défauts propres au produit lui-même.



Recyclage de votre ancien produit : Votre produit est conçu et fabriqué avec des matériaux et des composants de haute qualité, qui peuvent être recyclés et réutilisés. Lorsque le symbole de la poubelle barrée est apposé sur un produit, cela signifie que ce dernier est couvert par la directive européenne 2012/19/EU. Renseignez-vous sur le système local de collecte des produits électriques et électroniques. Respectez les règles locales et ne jetez pas vos anciens produits avec les ordures ménagères. L'élimination correcte de votre ancien produit contribuera à prévenir les conséquences négatives potentielles pour l'environnement et la santé humaine.

**DE LED-LICHTTHERAPIE-GESICHTSMASKE.** Schnellstart-Anleitung. **INHALT DER PACKUNG** Dieses Gerät ist wiederaufladbar und tragbar und kann ohne Anschluss an eine Steckdose verwendet werden. LED-Gesichtsmaske aus Silikon. Augensockelschutz (1 Paar). Steuergerät. Ladekabel (USB A auf C). Klettband (1 Paar). **KONTROLLIERT** Power-Taste Zum Ein- und Ausschalten 2s lang gedrückt halten. Standardmäßig ist Ihr Gerät so eingestellt, dass es sich nach 10 Minuten ausschaltet. Drücken Sie die Einschalttaste im eingeschalteten Zustand noch einmal, um den Timer zu unterbrechen. Modusauswahl. Drücken Sie einmal, um zwischen rotem, grünem, blauem, violett, türkistem, gelbem und weißem Licht zu wechseln. Jeder Lichtmodus ist mit Nahinfrarotlicht (NIR) kombiniert, um die Behandlungswirkung zu verstärken. Auf dem Bildschirm wird der entsprechende Lichtmodus angezeigt. Drücken Sie zweimal schnell, um zwischen 5 verschiedenen Intensitätsstufen zu wechseln. Auf dem Bildschirm wird die entsprechende Lichtintensität angezeigt. Zeitschaltuhr Drücken Sie einmal, um 1 Minute zu Ihrem Timer hinzuzufügen. Durch länges Drücken können Sie schnell weitere Minuten hinzufügen, bis zu einem Maximum von 30 Minuten. Ihr Gerät schaltet sich automatisch aus, wenn der Timer abgelaufen ist. **LICHTTHERAPIE-MODI** Jeder Lichtmodus ist mit Nahinfrarotlicht (NIR) kombiniert, das mit einer Wellenlänge von 850 nm tief in die Haut eindringt, um die Behandlungseffekte zu verstärken. Rotes Licht (640 nm + 850 nm) Steigert die Zellaktivität und fördert die Kollagenbildung, um die Hautelastizität zu verbessern und das Erscheinungsbild von Falten zu reduzieren. Blaues Licht (460 nm + 850 nm) Antibakteriell und entzündungshemmend zur Reduzierung von Akneausbrüchen und zur Hautregeneration. Grünes Licht (525 nm + 850 nm) Regt die Zellenergie an, um den Hautton auszugleichen, Rötungen und Hyperpigmentierung zu reduzieren. Cyan-Licht (460 nm + 525 nm) Beruhigt und entspannt gestresste Haut, fördert die Heilung und lindert Entzündungen. Gelbes Licht (640 nm + 525 nm + 850 nm) Fördert die Geweberegeneration zur Behandlung von Rosacea, reduziert Rötungen und verbessert das Hautbild. Violett Licht (640 nm + 460 nm + 850 nm) Multifrequenz-Behandlung zur gezielten Reduzierung von Akne und Aknenarben. Weißes Licht (640 nm + 525 nm + 460 nm + 850 nm) Dringt tiefer in die Haut ein, um den Hautstoffwechsel zu beschleunigen und die Nährstoffaufnahme zu verbessern. **SO INSTALLIEREN SIE DIE AUGENFASSUNG** Setzen Sie die Augenfassung vorsichtig von innen ein. Richtige Methode. **SO BEFESTIGEN SIE DIE RIEMEN** Führen Sie die Riemen ein und ziehen Sie sie mit Klettverschluss fest. **LADEN IHRES GERÄTS WARNUNG** Dies ist kein medizinisches Gerät und kann nicht für professionelle Behandlungen oder als Ersatz für professionelle medizinische Beratung verwendet werden. Die tatsächliche Wirkung der Anwendung variiert von Person zu Person. Verwenden Sie das Gerät nicht, während es aufgeladen wird. Wenn das Gerät während des Ladevorgangs übermäßig heiß wird, Rauch entwickelt oder einen ungewöhnlichen Geruch abgibt, trennen Sie bitte sofort das Ladegerät und kontaktieren Sie den Kundendienst. So laden Sie Ihr Gerät auf: Stecken Sie das USB-C-Kabel in den Controller und schließen Sie das andere Ende (USB-A) direkt an den USB-Anschluss des Netzteils an. Wenn das Batteriesymbol auf dem Controller-Bildschirm in einer Schleife blinkt, bedeutet dies, dass das Gerät gerade aufgeladen wird.

Sobald Ihr Gerät vollständig aufgeladen ist, bleibt das Batteriesymbol auf dem Controller-Bildschirm dauerhaft beleuchtet. Ein vollständiges Aufladen von 0 % dauert ca. 3,5 Stunden. Verwenden Sie die Maske nicht während des Ladevorgangs. Ladeleistung: 5V 1A max. **ANWENDUNGSHINWEISE** 1. Reinigen und trocknen Sie Ihr Gesicht vor der Anwendung. 2. Verbinden Sie Ihre LED-Lichttherapiemaske mit dem Controller. 3. Drücken Sie die POWER-Taste, um das Gerät einzuschalten. 4. Drücken Sie die MODE-Taste, um den gewünschten Lichttherapiemodus auszuwählen. 5. Drücken Sie die TIMER-Taste, um die Dauer Ihrer Lichttherapie-Sitzung einzustellen. Es wird empfohlen, jede Sitzung auf 10-15 Minuten einzustellen, mit einer maximalen Dauer von nicht mehr als 30 Minuten. 6. Drücken Sie die MODE-Taste zweimal schnell, um die Intensität der LED-Lichter anzupassen. 7. Dieses Produkt ist wiederaufladbar und tragbar und muss während der Anwendung nicht an eine Stromquelle angeschlossen sein. 8. Sobald der Timer abgelaufen ist und die Behandlung abgeschlossen ist, reinigen Sie die Maske mit einem weichen Handtuch. Tauchen Sie die Maske nicht in Wasser und spülen Sie sie nicht unter fließendem Wasser ab.

**Vorsichtsmaßnahmen** 1. Vermeiden Sie es, direkt in die LED-Lichter zu schauen. 2. Es ist ideal, die Augen während der Anwendung geschlossen zu halten – eine großartige Gelegenheit zur Entspannung! 3. Falten, quetschen oder drücken Sie die Maske nicht. 4. Reinigen Sie die Maske nicht durch Einweichen in Wasser. Wischen Sie sie einfach mit einem feuchten Tuch ab. Für eine gründlichere Reinigung wischen Sie die Maske sanft mit 70 % Alkohol ab. Die elastischen Bänder können vorsichtig mit Wasser gewaschen werden.

**WARNUNGEN** Dieses Produkt enthält ein Infrarotspektrum. Verwenden Sie dieses Gerät nicht länger als 30 Minuten am Stück. Schwangere Frauen, Kinder, Personen mit Epilepsie, Schilddrüsenpatienten oder Personen, die Schilddrüsenmedikamente einnehmen, sollten dieses Produkt nicht verwenden. Verwenden Sie das Gerät nicht bei Photoallergien oder während der Einnahme von Medikamenten, die Photoallergien oder Photosensibilität verursachen können. Vermeiden Sie Wunden und Bereiche mit Hauttraumata. Personen, die spezielle medizinische Implantate oder Herzfrequenzmessgeräte verwenden oder unter besonderen medizinischen Bedingungen leiden, sollten vor der Anwendung einen Arzt konsultieren. Bitte beachten Sie, dass die unsachgemäße Verwendung von LED-Gesichtsmasken möglicherweise zu Hautverfärbungen oder anderen Problemen führen kann. Personen, die spezielle medizinische Implantate oder Herzfrequenzmonitore verwenden oder unter besonderen medizinischen Bedingungen, Wunden im Gesicht oder Lichtempfindlichkeit leiden, sollten vor der Verwendung einen Arzt konsultieren. Werfen Sie die Batterie nicht ins Feuer und zerlegen Sie sie unter keinen Umständen. Dieses Gerät erfüllt die Anforderungen von Teil 15 der FCC-Vorschriften. Der Betrieb unterliegt den folgenden zwei Bedingungen: (1) Dieses Gerät darf keine schädlichen Interferenzen verursachen, und (2) dieses Gerät muss alle empfangenen Interferenzen akzeptieren, einschließlich Interferenzen, die einen unerwünschten Betrieb verursachen können.

**WARNUNGEN: SICHERE VERWENDUNG VON BATTERIEN** 1. Versuchen Sie nicht, den Akku zu zerlegen oder zu modifizieren. Andernfalls kann es zu Leckagen, Bränden oder Explosionen kommen, und die Garantie erlischt. Entsorgen Sie verbrauchte Batterien ordnungsgemäß und führen Sie sie dem Recycling zu. Beachten Sie stets die Richtlinien des Herstellers für die Pflege und Wartung von Batterien. 2. Lassen Sie den Akku Ihres Geräts nicht über einen längeren Zeitraum ungenutzt. Laden Sie den Akku mindestens alle drei Monate auf, um einen optimalen Zustand zu gewährleisten. 3. Um die Lebensdauer des Akkus zu verlängern, stellen Sie sicher, dass das Gerät nach dem Gebrauch innerhalb einer angemessenen Zeit aufgeladen wird. Eine zu lange Entladezeit kann die Leistung des Akkus beeinträchtigen. 4. Lagern Sie das Gerät nicht über einen längeren Zeitraum mit einem entladenen Akku. Laden Sie den Akku auf mindestens 50 % auf, bevor Sie ihn für längere Zeit lagern, um dauerhafte Schäden zu vermeiden.

**CE-INFORMATIONEN** NanoGrid Limited (Nanoleaf®) erklärt hiermit, dass dieses Gerät mit den grundlegenden Anforderungen und anderen relevanten Bestimmungen der Richtlinie 2014/53/EU übereinstimmt. Die Konformitätserklärung ist verfügbar unter <https://nanoleaf.me/eudocs>. **REINIGUNG UND WARTUNG** - Reinigen Sie das Gerät nicht mit Flüssigkeiten oder Sprays, wenn es an das Stromnetz angeschlossen ist. Reinigen Sie es mit einem weichen, trockenen Tuch und verwenden Sie keine aggressiven Reinigungsmittel.

**GARANTIEINFORMATIONEN** Für dieses Produkt gilt eine Garantie von einem Jahr ab Kaufdatum. Schäden, die durch Zeit und Gebrauch verursacht werden, fallen nicht unter die Servicegarantie. Die Garantie für dieses Produkt umfasst keine Ausfälle, die durch andere Faktoren als die Mängel des Produkts selbst verursacht werden.



Entsorgung Ihres alten Produkts: Ihr Produkt wurde mit hochwertigen Materialien und Komponenten entwickelt und hergestellt, die recycelt und wiederverwendet werden können. Wenn dieses Symbol einer durchgestrichenen Mülltonne an einem Produkt angebracht ist, bedeutet dies, dass das Produkt unter die europäische Richtlinie 2012/19/EU fällt. Bitte informieren Sie sich über Ihr lokales Sammelsystem für elektrische und elektronische Produkte. Bitte halten Sie sich an die örtlichen Vorschriften und

entsorgen Sie Ihre Altgeräte nicht über den normalen Hausmüll. Die korrekte Entsorgung Ihres Altgeräts trägt dazu bei, mögliche negative Folgen für die Umwelt und die menschliche Gesundheit zu vermeiden.

**ES La MÁSCARA FACIAL DE TERAPIA LED** es un dispositivo recargable y portátil que no necesita estar conectado a una toma de corriente durante su uso. **CONTENIDO DE LA CAJA:**

Máscara facial de silicona con LED, protectores de cuenca ocular (1 par), controlador, cable de carga (USB A a C) y correa de velcro (1 par). **CONTROLES:** (A) Botón de encendido:

Mantenga presionado 2s para encender/apagar. El dispositivo se apaga automáticamente después de 10 minutos. Presione nuevamente para pausar el temporizador. (B)

Selección de modo: Presione una vez para cambiar entre luz roja, verde, azul, púrpura, cian, amarilla y blanca, combinadas con luz infrarroja cercana (NIR) para mejorar los efectos del tratamiento. La pantalla mostrará el modo correspondiente. Presione dos veces rápidamente para ajustar entre 5 niveles de intensidad. (C) Temporizador: Presione una vez para agregar 1 minuto. Mantenga presionado para aumentar rápidamente hasta un máximo de 30 minutos. **MODOS DE TERAPIA LUMINOSA:** Cada modo combina NIR (850 nm) para

mejorar los efectos. Luz roja (640 nm + 850 nm): Aumenta la actividad celular y estimula la producción de colágeno para mejorar la elasticidad de la piel y reducir arrugas. Luz azul (460 nm + 850 nm): Antibacteriana y antiinflamatoria para reducir el acné y reparar la piel. Luz verde (525 nm + 850 nm): Equilibra el tono de la piel y reduce enrojecimiento e

hiperpigmentación. Luz cian (460 nm + 525 nm + 850 nm): Calma y alivia la piel estresada, promoviendo la cicatrización. Luz amarilla (640 nm + 525 nm + 850 nm): Ayuda a tratar la rosácea y mejora el tono general de la piel. Luz púrpura (640 nm + 460 nm + 850 nm): Trata el acné y las cicatrices de acné. Luz blanca (640 nm + 525 nm + 460 nm + 850 nm):

Penetra más profundamente para acelerar el metabolismo y mejorar la absorción de nutrientes. **INSTALACIÓN DE LA CUENCA OCULAR:** Colóquela suavemente desde el interior.

**COLOCACIÓN DE LAS CORREAS:** Inserte y ajuste con velcro. **CARGA DEL DISPOSITIVO:** Advertencia: No es un dispositivo médico ni sustituye asesoramiento profesional. No lo use mientras carga. Si emite calor excesivo, humo u olor inusual, desconéctelo y contacte con servicio al cliente. Conecte el cable USB-C al controlador y el extremo USB-A a la toma de corriente. La pantalla mostrará un icono parpadeante mientras carga y permanecerá encendido cuando esté completamente cargado (aprox. 3.5 h). Carga máx.: 5V 1A. **CÓMO**

**USAR:** 1. Limpie y seque su rostro. 2. Conecte la máscara al controlador. 3. Presione el botón de encendido. 4. Use el botón de modo para seleccionar el tipo de luz. 5. Ajuste la duración con el botón de temporizador (recomendada: 10-15 min, máx. 30 min). 6. Presione dos veces el botón de modo para ajustar la intensidad. 7. No necesita estar enchufado durante el uso. 8. Limpie la máscara con un paño suave tras cada sesión; no la sumerja en agua. **PRECAUCIONES:** 1. No mire directamente a las luces LED. 2. Mantenga los ojos cerrados durante el uso. 3. No doble ni presione la máscara. 4. No la sumerja en agua; límpiela con un paño húmedo o con alcohol al 70%. Las correas elásticas pueden lavarse con agua.

**ADVERTENCIAS** Este producto contiene un espectro infrarrojo. No use este dispositivo por más de 30 minutos seguidos. Las mujeres embarazadas, los niños, las personas con epilepsia, los pacientes con problemas de tiroides o aquellos que toman medicamentos para la tiroides no deben utilizar este producto. No lo use si tiene fotoalergias o mientras toma medicamentos que pueden causar fotoalergias o fotosensibilidad. Evite heridas y áreas con traumatismo cutáneo. Las personas que utilicen implantes médicos especiales, monitores de frecuencia cardíaca o que tengan condiciones médicas especiales deben consultar a un médico antes de su uso. Tenga en cuenta que el uso inadecuado de las máscaras faciales LED puede provocar un oscurecimiento de la piel u otros problemas. Las personas que utilicen implantes médicos especiales, monitores de frecuencia cardíaca o que tengan condiciones médicas especiales, heridas faciales o fotosensibilidad deben consultar a un médico antes de su uso. No desheche la batería en el fuego ni la desarme bajo ninguna circunstancia. Este dispositivo cumple con la Parte 15 de las Normas de la FCC. Su funcionamiento está sujeto a las siguientes dos condiciones: (1) este dispositivo no debe causar interferencias perjudiciales, y (2) este dispositivo debe aceptar cualquier interferencia recibida, incluida la interferencia que pueda causar un funcionamiento no deseado. ninguna parte del dispositivo con objetos punzantes, ya que esto hará que el dispositivo deje de funcionar tal y como está diseñado y puede implicar un riesgo para la seguridad. Si la cinta adhesiva es un componente de este producto, tenga en cuenta que no está diseñado para ser utilizado con paredes de ladrillo sin pintar, papel de pared, superficies irregulares/texturizadas o superficies muy porosas. Según corresponda, no utilice cinta adhesiva de doble cara para fijar cualquier parte del dispositivo a un techo o superficie con más de 90 grados con respecto al suelo, ya que el dispositivo se caerá con el tiempo, creando un peligro para la seguridad y un riesgo de daño para el dispositivo. Existen soluciones de montaje seguro opcionales para estos casos de uso, a veces mediante accesorios adicionales que se ofrecen para su compra por separado. Su garantía NO CUBRE los daños causados por la caída de dispositivos. El cable flexible y la fuente de alimentación no pueden ser sustituidos por otro producto de terceros. Si el cable está dañado, el controlador y la fuente de alimentación sólo podrán ser sustituidos por equipos originales fabricados por Nanoleaf®. El uso de cualquier componente de repuesto no

aprobado anulará la garantía y podrá implicar un grave peligro para la seguridad. Los paneles de luz Nanoleaf® están destinados principalmente para uso decorativo, con función de salida RVAB que puede atenuarse.

**ADVERTENCIAS: USO SEGURO DE LAS BATERÍAS** 1. No intente desarmar ni modificar la batería. Hacerlo puede provocar fugas, incendio o explosión y anulará la garantía. Se deben seguir los métodos adecuados de eliminación y reciclaje de baterías usadas. Consulte siempre las pautas del fabricante para el cuidado y mantenimiento de la batería. 2. No deje la batería de su dispositivo sin usar durante largos periodos. Para una salud óptima de la batería, cárguela al menos una vez cada tres meses. 3. Para mantener la vida útil de la batería, asegúrese de cargar el dispositivo poco tiempo después de usarlo. Un tiempo de descarga excesivo puede afectar negativamente el rendimiento de la batería. 4. Evite almacenar el dispositivo a largo plazo con la batería agotada. Cargue la batería al menos al 50 % antes de almacenarla durante periodos prolongados para evitar daños permanentes.

**INFORMACIÓN DE LA CE** NanoGrid Limited (Nanoleaf) declara por la presente que este dispositivo cumple con los requisitos esenciales y otras disposiciones pertinentes de la Directiva 2014/53/UE. La declaración de conformidad está disponible en <https://nanoleaf.me/eudocs>. **LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO** - No limpie el dispositivo con líquidos o aerosoles cuando esté conectado a la corriente. Límpielo con un paño seco y suave, y no use productos de limpieza agresivos.

**INFORMACIÓN SOBRE LA GARANTÍA** Este producto tiene una garantía de un año a partir de la fecha de compra. Los daños causados por el tiempo y el uso no están dentro del alcance de la garantía de servicio. El alcance de la garantía de este producto no incluye fallos causados por factores distintos a los defectos propios del producto.



Eliminación de su producto antiguo: Este producto está diseñado y fabricado con materiales y componentes de alta calidad, que pueden ser reciclados y reutilizados. Cuando este símbolo de contenedor de basura tachado está adjunto a un producto, significa que está cubierto por la Directiva Europea 2012/19/EU. Infórmese sobre el sistema de recogida local para productos eléctricos y electrónicos. Por favor, actúe de acuerdo con las normas locales y no deseche sus productos antiguos con la basura normal del hogar. La correcta eliminación de su producto antiguo ayudará a prevenir posibles consecuencias negativas para el medio ambiente y la salud humana.

**IT La MASCHERA FACCIALE A LUCE LED** è un dispositivo ricaricabile e portatile che può essere utilizzato senza essere collegato a una presa di corrente. **CONTENUTO DELLA CONFEZIONE:** Maschera facciale in silicone con LED, protezioni per le cavità oculari (1 paio), controller, cavo di ricarica (USB A-C) e cinturini in velcro (1 paio). **COMANDI:** (A) Pulsante di accensione: Tenere premuto per 2s per accendere/spegnere. Il dispositivo si spegne automaticamente dopo 10 minuti. Premere di nuovo per mettere in pausa il timer. (B) Selezione modalità: Premere una volta per scegliere tra luce rossa, verde, blu, viola, ciano, gialla e bianca, tutte abbinate alla luce a infrarossi vicini (NIR) per migliorare l'efficacia del trattamento. La modalità scelta verrà visualizzata sullo schermo. Premere due volte rapidamente per regolare l'intensità su 5 livelli. (C) Timer: Premere una volta per aggiungere 1 minuto. Tenere premuto per aumentare rapidamente fino a un massimo di 30 minuti. **MODALITÀ TERAPIA LED:** Ogni modalità include luce NIR (850 nm) per amplificare gli effetti. Luce rossa (640 nm + 850 nm): Stimola l'attività cellulare e la produzione di collagene per migliorare l'elasticità della pelle e ridurre le rughe. Luce blu (460 nm + 850 nm): Proprietà antibatteriche e antinfiammatorie per ridurre l'acne e riparare la pelle. Luce verde (525 nm + 850 nm): Equilibra il tono della pelle e riduce rossori e iperpigmentazione. Luce ciano (460 nm + 525 nm + 850 nm): Lenisce la pelle stressata, favorisce la guarigione e riduce l'infiammazione. Luce gialla (640 nm + 525 nm + 850 nm): Aiuta a trattare la rosacea e migliora l'uniformità dell'incarnato. Luce viola (640 nm + 460 nm + 850 nm): Specifica per acne e cicatrici da acne. Luce bianca (640 nm + 525 nm + 460 nm + 850 nm): Penetra più in profondità per accelerare il metabolismo cutaneo e migliorare l'assorbimento dei nutrienti. **INSTALLAZIONE PROTEZIONI OCULARI:** Inserire delicatamente dall'interno. **FISSAGGIO CINTURINI:** Inserire e stringere con il velcro. **RICARICA DEL DISPOSITIVO:** Avvertenza: Questo dispositivo non è un dispositivo medico e non sostituisce un trattamento professionale. Non usarlo durante la ricarica. Se emette calore eccessivo, fumo o odori insoliti, scollegarlo immediatamente e contattare l'assistenza clienti. Collegare il cavo USB-C al controller e il lato USB-A alla presa. L'icona della batteria lampeggia durante la ricarica e rimane accesa quando è completamente carica (circa 3,5 h). Ricarica max: 5V 1A. **COME USARE:** 1. Pulire e asciugare

il viso. 2. Collegare la maschera al controller. 3. Premere il pulsante di accensione. 4. Selezionare la modalità di terapia LED desiderata. 5. Impostare la durata con il pulsante timer (consigliato: 10-15 min, max 30 min). 6. Premere due volte rapidamente il pulsante modalità per regolare l'intensità. 7. Il dispositivo è portatile e non necessita di essere collegato alla corrente durante l'uso. 8. Dopo l'uso, pulire con un panno morbido senza immergere in acqua. **PRECAUZIONI:** 1. Non guardare direttamente le luci LED. 2. Tenere gli occhi chiusi durante l'uso per un maggiore relax. 3. Non piegare né premere la maschera. 4. Non immergere in acqua; pulire con un panno umido o alcol al 70%. I cinturini possono essere lavati delicatamente con acqua.

**AVVERTENZE** Questo prodotto contiene uno spettro di raggi infrarossi. Non utilizzare questo dispositivo per più di 30 minuti alla volta. Le donne incinte, i bambini, i soggetti affetti da epilessia, i pazienti affetti da tiroide o che assumono farmaci per la tiroide non devono utilizzare questo prodotto. Non utilizzare in caso di fotoallergie o durante l'assunzione di farmaci che possono causare fotoallergie o fotosensibilità. Evitare ferite e aree con traumi cutanei. Le persone che utilizzano impianti medici speciali, cardiofrequenzimetri o che hanno condizioni mediche particolari devono consultare un medico prima dell'uso. Si noti che l'uso improprio delle maschere facciali a LED può potenzialmente portare allo scurimento della pelle o ad altri problemi. I soggetti che utilizzano impianti medici speciali, cardiofrequenzimetri o che hanno condizioni mediche particolari, ferite al viso o fotosensibilità devono consultare un medico prima dell'uso. Non gettare la batteria nel fuoco e non smontarla in nessuna condizione. Questo dispositivo è conforme alla Parte 15 delle norme FCC. Il funzionamento è soggetto alle due condizioni seguenti: (1) il dispositivo non può causare interferenze dannose e (2) deve accettare qualsiasi interferenza ricevuta, comprese quelle che possono causare un funzionamento indesiderato.

**AVVERTENZE: USO SICURO DELLE BATTERIE** 1. Non tentare di smontare o modificare la batteria. Ciò potrebbe causare perdite, incendi o esplosioni e invalidare la garanzia. Le batterie usate devono essere smaltite e riciclate in modo appropriato. Fare sempre riferimento alle linee guida del produttore per la cura e la manutenzione delle batterie. 2. Non lasciare la batteria del dispositivo inutilizzata per lunghi periodi. Per una salute ottimale della batteria, caricarla almeno una volta ogni tre mesi. 3. Per mantenere la durata della batteria, assicurarsi che il dispositivo venga caricato entro un tempo ragionevole dopo l'uso. Un tempo di scarica eccessivo può influire negativamente sulle prestazioni della batteria. 4. Evitare di conservare a lungo il dispositivo con la batteria esaurita. Caricare la batteria almeno al 50% prima di conservarla per lunghi periodi per evitare danni permanenti.

**INFORMAZIONI CE** NanoGrid Limited (Nanoleaf®) dichiara che questo dispositivo è conforme ai requisiti essenziali e alle altre disposizioni pertinenti della Direttiva 2014/53/UE. La dichiarazione di conformità è disponibile sul sito <https://nanoleaf.me/eudocs>. **PULIZIA E MANUTENZIONE** - Non pulire il dispositivo con liquidi o spray quando è collegato alla corrente. Pulire con un panno morbido e asciutto e non usare detergenti aggressivi.

**INFORMAZIONI SULLA GARANZIA** Questo prodotto ha una garanzia di un anno dalla data di acquisto. I danni causati dal tempo e dall'uso non rientrano nell'ambito della garanzia di assistenza. L'ambito della garanzia di questo prodotto non comprende i guasti causati da fattori diversi dai difetti del prodotto stesso.



Smaltimento del vecchio prodotto: Il vostro prodotto è stato progettato e realizzato con materiali e componenti di alta qualità, che possono essere riciclati e riutilizzati. Quando il simbolo del cestinetto barrato è apposto su un prodotto, significa che il prodotto è coperto dalla Direttiva europea 2012/19/UE. Informatevi sul sistema locale di raccolta dei prodotti elettrici ed elettronici. Si prega di agire secondo le norme locali e di non smaltire i vecchi prodotti con i normali rifiuti domestici. Il corretto smaltimento del vecchio prodotto contribuirà a prevenire potenziali conseguenze negative per l'ambiente e la salute umana.

**PT A MÁSCARA FACIAL DE LUZ LED** é um dispositivo recarregável e portátil que pode ser utilizado sem estar conectado a uma tomada. **CONTEÚDO DA CAIXA:** Máscara facial de silicone com LED, protetores para os olhos (1 par), controlador, cabo de carregamento (USB A-C) e alças de velcro (1 par). **CONTROLES:** (A) Botão de energia: Pressione e segure por 2s para ligar/desligar. O dispositivo desliga automaticamente após 10 minutos. Pressione novamente para pausar o temporizador. (B) Seleção de modo: Pressione uma vez para escolher entre luz vermelha, verde, azul, roxo, ciano, amarela e branca, todas combinadas com luz infravermelha próxima (NIR) para melhorar os efeitos do tratamento. O modo selecionado será exibido na tela. Pressione duas vezes rapidamente para ajustar a intensidade em 5 níveis. (C) Temporizador: Pressione uma vez para adicionar 1 minuto. Pressione e

segure para aumentar rapidamente até um máximo de 30 minutos. **MODOS DE TERAPIA DE LUZ LED:** Cada modo inclui luz NIR (850 nm) para potencializar os efeitos. Luz vermelha (640 nm + 850 nm): Estimula a atividade celular e a produção de colágeno, melhorando a elasticidade da pele e reduzindo rugas. Luz azul (460 nm + 850 nm): Propriedades antibacterianas e anti-inflamatórias para reduzir a acne e reparar a pele. Luz verde (525 nm + 850 nm): Equilibra o tom da pele e reduz vermelhidão e hiperpigmentação. Luz ciano (460 nm + 525 nm + 850 nm): Acalma a pele estressada, promove a cicatrização e reduz a inflamação. Luz amarela (640 nm + 525 nm + 850 nm): Auxilia no tratamento da rosácea e melhora a uniformidade da pele. Luz roxa (640 nm + 460 nm + 850 nm): Indicada para acne e cicatrizes de acne. Luz branca (640 nm + 525 nm + 460 nm + 850 nm): Penetra mais profundamente para acelerar o metabolismo da pele e melhorar a absorção de nutrientes. **INSTALAÇÃO DOS PROTETORES OCULARES:** Insira delicadamente pelo lado interno. **FIXAÇÃO DAS ALÇAS:** Insira e ajuste com velcro. **CARREGAMENTO DO DISPOSITIVO:** Aviso: Este dispositivo não é um equipamento médico e não substitui tratamentos profissionais. Não utilize enquanto estiver carregando. Se emitir calor excessivo, fumaça ou odores incomuns, desconecte imediatamente e entre em contato com o suporte técnico. Conecte o cabo USB-C ao controlador e a outra extremidade USB-A à tomada. O ícone da bateria piscará durante o carregamento e permanecerá aceso quando estiver completamente carregado (aprox. 3,5 h). Taxa máxima de carregamento: 5V 1A. **COMO USAR:** 1. Limpe e seque o rosto. 2. Conecte a máscara ao controlador. 3. Pressione o botão de energia para ligar. 4. Selecione o modo de terapia LED desejado. 5. Ajuste a duração com o botão do temporizador (recomendado: 10-15 min, máximo 30 min). 6. Pressione duas vezes rapidamente o botão de modo para ajustar a intensidade. 7. O dispositivo é portátil e não precisa estar conectado à energia durante o uso. 8. Após o uso, limpe com um pano macio sem submergir em água. **PRECAUÇÕES:** 1. Não olhe diretamente para as luzes LED. 2. Mantenha os olhos fechados durante o uso para um maior relaxamento. 3. Não dobre nem pressione a máscara. 4. Não mergulhe em água; limpe com um pano úmido ou álcool 70%. As alças podem ser lavadas delicadamente com água.

**AVISOS** Este produto contém um espectro de infravermelhos. Não utilizar este aparelho durante mais de 30 minutos de cada vez. As mulheres grávidas, as crianças, os indivíduos com epilepsia, os doentes da tireoide ou os que tomam medicamentos para a tireoide não devem utilizar este produto. Não utilizar em caso de fotoalergias ou enquanto estiver a tomar medicamentos que possam causar fotoalergias ou fotossensibilidade. Evitar feridas e zonas com traumatismos cutâneos. As pessoas que utilizem implantes médicos especiais, monitores de ritmo cardíaco ou que tenham condições médicas especiais devem consultar um médico antes da utilização. Tenha em atenção que a utilização incorrecta de máscaras faciais LED pode potencialmente provocar o escurecimento da pele ou outros problemas. As pessoas que utilizem implantes médicos especiais, monitores de ritmo cardíaco ou que tenham condições médicas especiais, feridas faciais ou fotossensibilidade devem consultar um médico antes de as utilizar. Não deite a bateria no fogo nem a desmonte em nenhuma circunstância. Este dispositivo está em conformidade com a Parte 15 das normas da FCC. O funcionamento está sujeito às duas condições seguintes: (1) este dispositivo não pode causar interferências prejudiciais e (2) este dispositivo tem de aceitar quaisquer interferências recebidas, incluindo interferências que possam causar um funcionamento indesejado.

**AVISOS: UTILIZAÇÃO SEGURA DAS PILHAS** 1. Não tente desmontar ou modificar a bateria. Se o fizer, pode provocar fugas, incêndios ou explosões e anulará a garantia. Devem ser seguidos métodos corretos de eliminação e reciclagem para as baterias usadas. Consulte sempre as diretrizes do fabricante para cuidados e manutenção da bateria. 2. Não deixe a bateria do seu dispositivo sem utilização durante longos períodos de tempo. Para otimizar a saúde da bateria, carregue-a pelo menos uma vez a cada três meses. 3. Para manter a vida útil da bateria, certifique-se de que o dispositivo é carregado num período de tempo razoável após a utilização. Um tempo de descarga excessivo pode afetar negativamente o desempenho da bateria. 4. Evite o armazenamento a longo prazo do dispositivo com uma bateria descarregada. Carregue a bateria até, pelo menos, 50% antes de a guardar durante longos períodos de tempo, para evitar danos permanentes.

**INFORMAÇÕES CE** A NanoGrid Limited (Nanoleaf®) declara que este dispositivo está em conformidade com os requisitos essenciais e outras disposições relevantes da Diretiva 2014/53/UE. A declaração de conformidade está disponível em <https://nanoleaf.me/eudocs>. **LIMPEZA E MANUTENÇÃO** - Não limpe o dispositivo com líquidos ou sprays quando estiver ligado à eletricidade. Limpe com um pano macio e seco e não use produtos de limpeza agressivos.

**INFORMAÇÕES SOBRE A GARANTIA** Este produto tem uma garantia de um ano a partir da data de compra. Os danos causados pelo tempo e pela utilização não estão abrangidos pela garantia de serviço. O âmbito da garantia deste produto não inclui falhas causadas por outros factores que não os defeitos do próprio produto.



Eliminação do seu produto antigo: O seu produto foi concebido e fabricado com materiais e componentes de alta qualidade, que podem ser reciclados e reutilizados. Quando este símbolo do caixote do lixo barrado com uma cruz está afixado a um produto, significa que o produto está abrangido pela Diretiva Europeia 2012/19/UE. Informe-se sobre o seu sistema local de recolha de produtos eléctricos e electrónicos. Aja de acordo com as regras locais e não deite fora os seus produtos usados juntamente com o lixo doméstico normal. A eliminação correta do seu produto usado ajudará a evitar potenciais consequências negativas para o ambiente e a saúde humana.

**BG LED ТЕРАПЕВТИЧНА МАСКА ЗА ЛИЦЕ** – Бързо ръководство. Това устройство е презареждаемо и преносимо и може да се използва без свързване към електрическата мрежа. **Какво има в кутията?** Силиконова LED маска за лице, предпазители за очите (1 чифт), контролер, кабел за зареждане (USB A-C), велкро лента (1 чифт). **Контроли:** (A) Бутон за захранване – Натиснете и задръжте за 2 секунди, за да включите/изключите. Устройството се изключва автоматично след 10 минути. Натиснете отново, за да паузирате таймера. (B) Избор на режим – Натиснете веднъж, за да превключите между червена, зелена, синя, лилава, циан, жълта и бяла светлина, всяка комбинирана с близка инфрачервена светлина (NIR) за подобряване на ефекта. Екранът ще покаже избрания режим. Натиснете два пъти бързо, за да регулирате интензивността в 5 нива. (C) Таймер – Натиснете веднъж, за да добавите 1 минута. Натиснете и задръжте, за да увеличите времето по-бързо до максимум 30 минути. **LED светотерапевтични режими:** Всеки режим включва NIR светлина (850 nm) за засилване на ефекта. Червена светлина (640 nm + 850 nm) – Стимулира клетъчната активност и производството на колаген, подобрява еластичността на кожата и намалява бръчките. Синя светлина (460 nm + 850 nm) – Антибактериално и противовъзпалително действие за намаляване на акнето и възстановяване на кожата. Зелена светлина (525 nm + 850 nm) – Изравнява тена, намалява зачервяванията и хиперпигментацията. Циан светлина (460 nm + 525 nm + 850 nm) – Успокоява раздразнената кожа, подпомага заздравяването и намалява възпаленията. Жълта светлина (640 nm + 525 nm + 850 nm) – Подобрява заздравяването на тъканите, помага при розацеа и намалява зачервяването. Лилава светлина (640 nm + 460 nm + 850 nm) – Комбинирана терапия за акне и белези. Бяла светлина (640 nm + 525 nm + 460 nm + 850 nm) – Прониква дълбоко в кожата, ускорява метаболизма и подобрява усвояването на хранителни вещества. **Как да инсталирате предпазители за очи:** Внимателно ги поставете отвътре. **Как да закрепите лентите:** Поставете ги и затегнете с велкро. **Зареждане на устройството:** ВНИМАНИЕ: Това не е медицинско устройство и не замества професионално лечение. Ефектът може да варира. Не използвайте устройството, докато се зарежда. Ако стане прекалено горещо, изпуска дим или необичайна миризма, прекъснете зареждането и се свържете с обслужване на клиенти. Свържете USB-C кабела към контролера и включете USB-A края в зарядното. Ако иконата на батерията мига, устройството се зарежда. След пълно зареждане (около 3,5 часа) иконата ще остане включена. **Как да използвате:** 1. Почистете и подсушете лицето. 2. Свържете LED маската към контролера. 3. Натиснете бутона за захранване. 4. Изберете светлинен режим. 5. Настройте времетраенето (препоръчително 10–15 минути, максимум 30 минути). 6. Натиснете два пъти бързо бутона за режим, за да регулирате интензивността. 7. Устройството е преносимо и не изисква връзка към електричество по време на употреба. 8. След употреба изберете маската с мека кърпа. Не я потапяйте във вода. **Предпазни мерки:** 1. Не гледайте директно в LED светлините. 2. Дръжте очите си затворени по време на употреба. 3. Не съгвайте, не натискайте и не притискайте маската. 4. Не потапяйте маската във вода – почиствайте я с влажна кърпа. За по-дълбоко почистване използвайте 70% спирт. Еластичните ленти могат да се перат внимателно с вода.

**ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ** Този продукт съдържа инфрачервен спектър. Не използвайте това устройство повече от 30 минути едновременно. Бременни жени, деца, лица с епилепсия, пациенти с щитовидна жлеза или такива, които приемат лекарства за щитовидна жлеза, не трябва да използват този продукт. Не използвайте при фотоалергии или докато приемате лекарства, които могат да предизвикат фотоалергии ро фоточувствителност. Избягвайте рани и участъци с кожни травми. Лица, които използват специални медицински импланти, монитори за сърдечен ритъм или имат специални медицински състояния, трябва да се консултират с лекар преди употреба. Моля, имайте предвид, че неправилната употреба на LED маски за лице може потенциално да доведе до потъмняване на кожата или други проблеми. Лица, които използват специални медицински импланти, монитори за сърдечен ритъм или имат специални медицински състояния, рани на лицето или фоточувствителност, трябва да се консултират с лекар преди употреба. Не изхвърляйте батерията в огъня и не я разглобявайте при никакви условия. Това устройство отговаря на изискванията на част 15 от правилата на FCC. Експлоатацията е предмет на следните две условия: (1) това устройство не може да причинява вредни смущения и (2) това устройство трябва да приема всички получени смущения, включително смущения, които могат да причинят нежелана работа.

**ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ: БЕЗОПАСНА УПОТРЕБА НА БАТЕРИИ** 1. Не се опитвайте да разглобявате или модифицирате батерията. Това може да доведе до изтичане, пожар или експлозия и ще доведе до прекратяване на гаранцията. За използваните батерии трябва да се спазват правилните методи за изхвърляне и рециклиране. Винаги се съобразявайте с указанията на производителя за грижа и поддръжка на батерията. 2. Не оставяйте батерията на вашето устройство неизползвана за продължителни периоди от време. За оптимално състояние на батерията зареждайте батерията поне веднъж на всеки три месеца. 3. За да запазите живота на батерията, уверете се, че устройството е заредено в разумен срок след употреба. Прекалено дългото време за зареждане може да се отрази неблагоприятно на работата на батерията. 4. Избягвайте продължително съхранение на устройството с изтощена батерия. Зареждайте батерията до поне 50%, преди да я съхранявате продължително време, за да предотвратите трайно увреждане.

**ИНФОРМАЦИЯ ЗА СЕ** С настоящото NanoGrid Limited (Nanoleaf®) декларира, че това изделие е в съответствие със съществените изисквания и други съответни разпоредби на Директива 2014/53/ЕС. Декларацията за съответствие е достъпна на адрес <https://nanoleaf.me/eudocs>. **Почистване и поддръжка** – Не почиствайте устройството с течности или спрейове, когато е свързано към захранването. Почиствайте с мека суха кърпа и не използвайте агресивни почистващи препарати.

**ГАРАНЦИОННА ИНФОРМАЦИЯ** Този продукт има едногодишна гаранция от датата на закупуване. Повредите, причинени от времето и употребата, не попадат в обхвата на сервизната гаранция. Обхватът на гаранцията на този продукт не включва повреди, причинени от фактори, различни от дефектите на самия продукт.



Изхвърляне на стария ви продукт: Вашият продукт е проектиран и произведен с висококачествени материали и компоненти, които могат да бъдат рециклирани и използвани повторно. Когато този символ за зачеркнато кошче за боклук е приклепен към даден продукт, това означава, че продуктът е обхванат от Европейската директива 2012/19/ЕС. Моля, информирайте се за вашата местна система за събиране на електрически и електронни продукти. Моля, действайте в съответствие с местните правила и не изхвърляйте старите си продукти заедно с нормалните битови отпадъци. Правилното изхвърляне на вашия стар продукт ще помогне да се предотвратят потенциални негативни последици за околната среда и човешкото здраве.

**CS LED TERAPEUTICKÁ MASKA NA OBLIČEJ** – Rychlý průvodce. Toto zařízení je nabíjecí a přenosné, lze jej používat bez připojení k elektrické síti. **Co je v balení?** Silikonová LED maska na obličej, chrániče očí (1 pár), ovladač, nabíjecí kabel (USB A-C), suchý zip (1 pár). **Ovládání:** (A) Tlačítko napájení – Podržte 2 sekundy pro zapnutí/vypnutí. Zařízení se automaticky vypne po 10 minutách. Dalším stisknutím lze časovač pozastavit. (B) Výběr režimu – Stiskněte jednou pro přepínání mezi červeným, zeleným, modrým, fialovým, tyrkysovým, žlutým a bílým světlem. Každý režim je kombinován s blízkým infračerveným světlem (NIR) pro zesílení účinku. Na obrazovce se zobrazí zvolený režim. Rychlým dvojitým stiskem lze nastavit intenzitu ve 5 úrovních. (C) Časovač – Stiskněte jednou pro přidání 1 minuty. Dlouhým stiskem lze rychle přidat více minut až do maximálního času 30 minut. **Režimy světelné terapie:** Každý režim obsahuje NIR světlo (850 nm) pro zvýšení účinnosti. Červené světlo (640 nm + 850 nm) – Podporuje buněčnou aktivitu a tvorbu kolagenu, zlepšuje pružnost pokožky a redukuje vrásky. Modré světlo (460 nm + 850 nm) – Má antibakteriální a protizánětlivé účinky, pomáhá redukovat akné a regenerovat pokožku. Zelené světlo (525 nm + 850 nm) – Stimuluje buněčnou energii, sjednocuje tón pleti, redukuje zarudnutí a hyperpigmentaci. Tyrkysové světlo (460 nm + 525 nm + 850 nm) – Uklidňuje podrážděnou pokožku, podporuje hojení a snižuje záněty. Žluté světlo (640 nm + 525 nm + 850 nm) – Podporuje hojení tkání, pomáhá při růžovce a redukuje zarudnutí. Fialové světlo (640 nm + 460 nm + 850 nm) – Kombinovaná terapie zaměřená na akné a jizvy. Bílé světlo (640 nm + 525 nm + 460 nm + 850 nm) – Proniká hluboko do pokožky, urychluje metabolismus a zlepšuje vstřebávání živin. **Jak nasadit chrániče očí:** Opatrně je vložte dovnitř masky. **Jak upevnit pásky:** Vložte pásky a utáhněte suchým zipem. **Nabíjení zařízení:** UPOZORNĚNÍ: Toto není zdravotnický prostředek a nenahrazuje odbornou léčbu. Účinky se mohou lišit. Nepoužívejte zařízení během nabíjení. Pokud se zařízení nadměrně zahřívá, kouří nebo vydává neobvyklý zápach, okamžitě odpojte nabíječku a kontaktujte zákaznickou podporu. Nabíjejte zařízení připojením USB-C kabelu do ovladače a USB-A konektoru do zásuvky. Blikající ikona baterie na displeji znamená nabíjení. Po úplném nabití (cca 3,5 hodiny) zůstane ikona trvale svítit. **Jak používat:** 1. Před použitím si vyčistěte a osušte obličej. 2. Připojte LED masku k ovladači. 3.

Stiskněte tlačítko napájení. 4. Vyberte režim světelné terapie. 5. Nastavte dobu terapie (doporučeno 10–15 minut, maximálně 30 minut). 6. Rychlým dvojitém stiskem tlačítka režimu upravte intenzitu světla. 7. Zařízení je přenosné a nevyžaduje připojení k síti během používání. 8. Po ukončení terapie otřete masku měkkým hadříkem. Nepoužívejte vodu ani masku neponožte. **Bezpečnostní opatření:** 1. Nedívejte se přímo do LED světla. 2. Mějte oči zavřené během používání – ideální čas na relaxaci! 3. Masku neskládejte, nemačkejte ani na ni netlačte. 4. Při čištění masky ji nenamáčejte do vody – otřete ji vlhkým hadříkem. Pro důkladnější čištění použijte 70% alkohol. Elastické pásky lze jemně prát ve vodě.

**VAROVÁNÍ** Tento výrobek obsahuje infračervené spektrum. Nepoužívejte tento přístroj déle než 30 minut v kuse. Tento výrobek by neměly používat těhotné ženy, děti, osoby s epilepsi, pacienti se štítnou žlázou nebo osoby užívající léky na štítnou žlázu. Nepoužívejte při fotoalergii nebo při užívání léků, které mohou způsobovat fotoalergie ro fotosenzitivitu. Vyhněte se poraněním a místům s poraněnou kůží. Osoby, které používají speciální lékařské implantáty, monitory srdečního tepu nebo mají zvláštní zdravotní potíže, by se měly před použitím poradit s lékařem. Upozorňujeme, že nesprávné používání obličejových masek LED může potenciálně vést ke ztmavnutí pokožky nebo jiným problémům. Osoby, které používají speciální lékařské implantáty, monitory srdečního tepu nebo mají zvláštní zdravotní potíže, poranění obličeje nebo fotosenzitivitu, by se měly před použitím poradit s lékařem. Baterii v žádném případě nevyhazujte do ohně ani ji nerozebírejte. Toto zařízení splňuje požadavky části 15 pravidel FCC. Provoz podléhá následujícím dvěma podmínkám: (1) toto zařízení nesmí způsobovat škodlivé rušení a (2) toto zařízení musí akceptovat veškeré přijaté rušení, včetně rušení, které může způsobit nežádoucí provoz.

**VAROVÁNÍ: BEZPEČNÉ POUŽÍVÁNÍ BATERIÍ** 1. Nepokoušejte se baterii rozebrat nebo upravit. Takové jednání může vést k vytečení, požáru nebo výbuchu a vede ke ztrátě záruky. U použitých baterií je třeba dodržovat správné metody likvidace a recyklace. Vždy se řiďte pokyny výrobce pro péči a údržbu baterií. 2. Nenechávejte baterii v zařízení delší dobu nepoužívanou. Pro optimální stav baterie ji nabíjejte alespoň jednou za tři měsíce. 3. Pro zachování životnosti baterie zajistěte, aby bylo zařízení po použití v přiměřené době nabito. Nadměrná doba vybíjení může nepříznivě ovlivnit výkon baterie. 4. Vyvarujte se dlouhodobého skladování zařízení s vybitou baterií. Před dlouhodobým skladováním nabíjete baterii alespoň na 50 %, abyste zabránili jejímu trvalému poškození.

**INFORMACE CE** Společnost NanoGrid Limited (Nanoleaf®) tímto prohlašuje, že toto zařízení je v souladu se základními požadavky a dalšími příslušnými ustanoveními směrnice 2014/53/EU. Prohlášení o shodě je k dispozici na adrese <https://nanoleaf.me/eudocs>. **ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA** – Nečistěte zařízení kapalinami nebo spreji, když je připojeno k napájení. Čistěte měkkým suchým hadříkem a nepoužívejte agresivní čisticí prostředky.

**INFORMACE O ZÁRUCE** Na tento výrobek se vztahuje jednoletá záruka od data zakoupení. Na poškození způsobená časem a používáním se servisní záruka nevztahuje. Rozsah záruky na tento výrobek nezahrnuje poruchy způsobené jinými faktory než vadami samotného výrobku.



Likvidace starého výrobku: Váš výrobek je navržen a vyroben z vysoce kvalitních materiálů a komponentů, které lze recyklovat a znovu použít. Pokud je na výrobku uveden tento symbol přeškrtnutého odpadkového koše, znamená to, že se na výrobek vztahuje evropská směrnice 2012/19/EU. Informujte se o místním systému sběru elektrických a elektronických výrobků. Chovejte se prosím podle místních pravidel a nelikvidujte staré výrobky společně s běžným domovním odpadem. Správná likvidace vašeho starého výrobku pomůže zabránit možným negativním důsledkům pro životní prostředí a lidské zdraví.

**DA LED LYSTERAPI ANSIGTSMASKE** – Hurtig startguide. **Hvad er i æsken?** En genopladelig og bærbær enhed, der kan bruges uden at være tilsluttet en stikkontakt. Indeholder: Silikone LED-ansigtsmaske, øjenbeskyttere (1 par), controller, opladerkabel (USB A til C) og velcrobånd (1 par). **Kontroller:** (A) Tænd/sluk-knap – Hold nede i 2 sekunder for at tænde/slukke. Enheden slukker automatisk efter 10 minutter, medmindre du trykker igen for at pause timeren. (B) Tilstandsvælger – Tryk én gang for at skifte mellem rød, grøn, blå, lilla, cyan, gul og hvid lysstyrke. Hver tilstand kombineres med nær-infrarød lys (NIR) for forbedret effekt. Skærmen viser den valgte tilstand. Tryk to gange hurtigt for at justere lysstyrken i 5 niveauer. (C) Timer – Tryk én gang for at tilføje 1 minut, hold nede for hurtigere justering op til max. 30 minutter. Enheden slukker automatisk, når tiden er gået. **Lysterapi-tilstande:** Hver tilstand inkluderer NIR-lys (850 nm) for dybere effekt. Rødt lys (640 nm + 850 nm) – Øger celleaktivitet, fremmer kollagenproduktion, forbedrer hudens elasticitet og reducerer rynker. Blåt lys (460 nm + 850 nm) – Har antibakterielle og antiinflammatoriske egenskaber, reducerer akneudbrud og fremmer heling. Grønt lys (525 nm + 850 nm) – Stimulerer celleenergi, udløser

hudtonen og mindsker rødme og hyperpigmentering. Cyan lys (460 nm + 525 nm + 850 nm) – Beroliger og heler stresset hud, reducerer inflammation. Gult lys (640 nm + 525 nm + 850 nm) – Fremmer vævsheling, hjælper mod rosacea og forbedrer hudtonen. Lilla lys (640 nm + 460 nm + 850 nm) – Måltrettet behandling af akne og akne-år. Hvidt lys (640 nm + 525 nm + 460 nm + 850 nm) – Trænger dybere ind i huden, øger stofskiftet og optimerer næringsoptagelsen. **Installation af øjenbeskyttere:** Indsæt forsigtigt fra undersiden. **Fastgørelse af stropper:** Sæt stropperne i og stram med velcro. **Opladning:** Advarsel! Dette er ikke et medicinsk udstyr og bør ikke erstatte professionel behandling. Brug ikke enheden under opladning. Hvis den bliver overophedet, ryger eller lugter unormalt, skal du straks afbryde opladningen og kontakte kundeservice. Tilslut USB-C-kablet til kontrolløren og USB-A-stikket til en strømforsyning. Et blinkende batteriikon betyder, at enheden oplades. Når den er fuldt opladet (ca. 3,5 timer), lyser batteriikonet konstant. **Brugsvejledning:** 1. Rens og tør dit ansigt. 2. Tilslut LED-masken til kontrolløren. 3. Tænd enheden. 4. Vælg lysterapi-tilstand. 5. Indstil behandlingstiden (10–15 min anbefalet, max 30 min). 6. Tryk to gange hurtigt for at justere lysintensiteten. 7. Enheden er bærbar og kræver ikke strømtilslutning under brug. 8. Efter brug tørres masken med en blød klud. **Forholdsregler:** 1. Undgå at kigge direkte ind i LED-lyset. 2. Hold øjnene lukkede under brug – perfekt tid til afslapning! 3. Masken må ikke foldes, presses eller klemmes. 4. Rengør masken med en fugtig klud – undgå vand. Brug 70% alkohol til dybderens. Stropperne kan vaskes forsigtigt i vand.

**ADVARSLER** Dette produkt indeholder et infrarødt spektrum. Brug ikke denne enhed i mere end 30 minutter ad gangen. Gravide, børn, personer med epilepsi, skjoldbruskkirtelpatienter eller personer, der tager medicin mod skjoldbruskkirtlen, bør ikke bruge dette produkt. Må ikke bruges ved fotoallergi, eller mens man tager medicin, der kan forårsage fotoallergi eller lysfølsomhed. Undgå sår og områder med hudtraumer. Personer, der bruger særlige medicinske implantater, pulsmålere eller har særlige medicinske tilstande, bør rådføre sig med en læge før brug. Bemærk, at forkert brug af LED-ansigtsmasker potentielt kan føre til mørkfarvning af huden eller andre problemer. Personer, der bruger særlige medicinske implantater, pulsmålere eller har særlige medicinske tilstande, sår i ansigtet eller lysfølsomhed, bør konsultere en læge før brug. Batteriet må ikke smides i ilden eller skilles ad under nogen omstændigheder. Denne enhed overholder del 15 i FCC-reglerne. Betjening er underlagt følgende to betingelser: (1) denne enhed må ikke forårsage skadelig interferens, og (2) denne enhed skal acceptere enhver modtaget interferens, herunder interferens, der kan forårsage uønsket drift.

**ADVARSLER: SIKKER BRUG AF BATTERIER** 1. Forsøg ikke at adskille eller modificere batteriet. Det kan føre til lækage, brand eller eksplosion, og garantien bortfalder. Brugte batterier skal bortskaffes og genbruges korrekt. Se altid producentens retningslinjer for batteriopleje og -vedligeholdelse. 2. Lad ikke enhedens batteri være ubrugt i længere perioder. Oplad batteriet mindst en gang hver tredje måned for at opnå optimal batterisundhed. 3. For at bevare batteriets levetid skal du sørge for, at enheden oplades inden for en rimelig tid efter brug. For lang afladningstid kan påvirke batteriets ydeevne negativt. 4. Undgå langtidsopbevaring af enheden med et afladet batteri. Oplad batteriet til mindst 50 %, før du opbevarer det i længere tid, for at forhindre permanent skade.

**CE-INFORMATION** NanoGrid Limited (Nanoleaf®) erklærer hermed, at denne enhed er i overensstemmelse med de væsentlige krav og andre relevante bestemmelser i direktiv 2014/53/EU. Overensstemmelseserklæringen er tilgængelig på <https://nanoleaf.me/eudocs>. **RENGØRING OG VEDLIGEHOLDELSE** – Rengør ikke enheden med væsker eller sprays, når den er tilsluttet strøm. Rengør med en blød, tør klud, og brug ikke skrappere rengøringsmidler.

**GARANTIOPLYSNINGER** Dette produkt har et års garanti fra købsdatoen. Skaden forårsaget af tid og brug er ikke omfattet af servicegarantien. Garantien for dette produkt omfatter ikke fejl, der skyldes andre faktorer end fejl ved selve produktet.



Bortskaffelse af dit gamle produkt: Dit produkt er designet og fremstillet af materialer og komponenter af høj kvalitet, som kan genbruges og genanvendes. Når dette overkrydsede skraldespandssymbol er knyttet til et produkt, betyder det, at produktet er omfattet af det europæiske direktiv 2012/19/EU. Find ud af mere om dit lokale indsamlingssystem for elektriske og elektroniske produkter. Følg de lokale regler, og smid ikke dine gamle produkter ud sammen med dit normale husholdningsaffald. Korrekt bortskaffelse af dit gamle produkt vil hjælpe med at forhindre potentielle negative konsekvenser for miljøet og menneskers sundhed.

**EL ΜΑΣΚΑ ΠΡΟΣΩΠΟΥ LED ΦΩΤΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ** – Οδηγός χρήσης εκκίνησης. **ΤΙ ΠΕΡΙΕΧΕΤΑΙ ΣΤΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ;** Η συσκευή είναι επαναφορτιζόμενη, φορητή και μπορεί να χρησιμοποιηθεί χωρίς

να είναι συνδεδεμένη σε πρίζα. **Περιλαμβάνει:** Μάσκα σιλικόνης LED, προστατευτικά ματιών (1 ζευγάρι), χειριστήριο, καλώδιο φόρτισης (USB A σε C) και λουράκια velcro (1 ζευγάρι). **ΧΕΙΡΙΣΜΟΙ:** (Α) Κουμπί λειτουργίας – Πατήστε και κρατήστε για 2 δευτερόλεπτα για ενεργοποίηση/απενεργοποίηση. Η συσκευή απενεργοποιείται αυτόματα μετά από 10 λεπτά, εκτός αν πατήσετε ξανά το κουμπί για παύση του χρονοδιακόπτη. (Β) Επιλογή λειτουργίας – Πατήστε μία φορά για εναλλαγή μεταξύ κόκκινου, πράσινου, μπλε, μοβ, κίτρινου και λευκού φωτός. Κάθε λειτουργία συνδυάζεται με υπέρυθρο φως (NIR) για ενίσχυση της θεραπείας. Η οθόνη εμφανίζει την αντίστοιχη λειτουργία. Πατήστε δύο φορές γρήγορα για να αλλάξετε την ένταση σε 5 επίπεδα. (C) Χρονοδιακόπτης – Πατήστε μία φορά για να προσθέσετε 1 λεπτό, κρατήστε πατημένο για να αυξήσετε γρήγορα τον χρόνο έως 30 λεπτά. Η συσκευή απενεργοποιείται αυτόματα όταν λήξει ο χρόνος. **ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΦΩΤΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ:** Κάθε λειτουργία περιλαμβάνει υπέρυθρο φως (NIR) 850nm για ενίσχυση της δράσης. Κόκκινο φως (640nm + 850nm) – Αυξάνει τη δραστηριότητα των κυττάρων, προάγει την παραγωγή κολλαγόνου, βελτιώνει την ελαστικότητα και μειώνει τις ρυτίδες. Μπλε φως (460nm + 850nm) – Αντιβακτηριδιακή και αντιφλεγμονώδης δράση, μειώνει την ακμή και επανορθώνει το δέρμα. Πράσινο φως (525nm + 850nm) – Εξισορροπίζει τον τόνο της επιδερμίδας, μειώνει την ερυθρότητα και τις δυσχρωμίες. Κίτρινο φως (460nm + 525nm + 850nm) – Καταπραύνει και επουλώνει το δέρμα, μειώνει τις φλεγμονές. Κίτρινο φως (640nm + 525nm + 850nm) – Βοηθά στην επώλωση των ιστών, αντιμετωπίζει τη ροδόχρου ακμή και βελτιώνει τον τόνο του δέρματος. Μοβ φως (640nm + 460nm + 850nm) – Στοχεύει στην ακμή και στα σημάδια της. Λευκό φως (640nm + 525nm + 460nm + 850nm) – Διεσθύνει βαθύτερα, επιταχύνει τον μεταβολισμό του δέρματος και βελτιώνει την απορρόφηση θρεπτικών συστατικών. **Τοποθέτηση προστατευτικών ματιών:** Εισάγετε απαλά από το εσωτερικό. **Στερέωση λουριών:** Περάστε και σφιξίτε με velcro. **ΦΟΡΤΙΣΗ:** Προειδοποίηση! Η συσκευή δεν είναι ιατρικό προϊόν και δεν αντικαθιστά επαγγελματικές θεραπείες. Μην τη χρησιμοποιείτε κατά τη φόρτιση. Αν υπερθερμανθεί, καπνίσει ή μυρίσει περίεργα, αποσυνδέστε αμέσως τον φορτιστή και επικοινωνήστε με την υποστήριξη. Φορτίστε μέσω USB-C στο χειριστήριο και USB-A σε πηγή ρεύματος. Το αναρροβήντον εικονίδιο μπαταρίας δείχνει ότι φορτίζει. Πλήρης φόρτιση (0-100%) σε περίπου 3,5 ώρες. **ΧΡΗΣΗ:** 1. Καθαρίστε και στεγνώστε το πρόσωπό σας. 2. Συνδέστε τη μάσκα στο χειριστήριο. 3. Πατήστε το κουμπί λειτουργίας. 4. Επιλέξτε τη λειτουργία φωτός. 5. Ρυθμίστε τη διάρκεια (10-15 λεπτά προτεινόμενη, max 30 λεπτά). 6. Πατήστε δύο φορές γρήγορα για προσαρμογή έντασης. 7. Η συσκευή είναι φορητή και δεν απαιτεί ρεύμα κατά τη χρήση. 8. Σκουπίστε τη μάσκα με ένα μαλακό πανί μετά τη χρήση. **ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ:** 1. Μην κοιτάτε απευθείας το LED φως. 2. Κρατήστε τα μάτια σας κλειστά κατά τη χρήση. 3. Μην διπλώνετε ή πιέζετε τη μάσκα. 4. Μην την πλένετε με νερό – σκουπίστε με υγρό πανί ή 70% αλκοόλη. Τα λουράκια μπορούν να πλυθούν με νερό.

**ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ** Αυτό το προϊόν περιέχει υπέρυθρο φάσμα. Μην χρησιμοποιείτε αυτή τη συσκευή για περισσότερο από 30 λεπτά τη φορά. Οι έγκυες γυναίκες, τα παιδιά, τα άτομα με επιληψία, οι ασθενείς με θυρεοειδή ή όσοι λαμβάνουν φάρμακα για τον θυρεοειδή δεν πρέπει να χρησιμοποιούν αυτό το προϊόν. Μην τη χρησιμοποιείτε με φωτοαλλεργίες ή κατά τη λήψη φαρμάκων που μπορεί να προκαλέσουν φωτοαλλεργίες ή φωτοευαισθησία. Αποφύγετε τις πληγές, και περιοχές με τραύμα στο δέρμα. Άτομα που χρησιμοποιούν ειδικά ιατρικά εμφυτεύματα, συσκευές παρακολούθησης καρδιακού ρυθμού ή έχουν ειδικές ιατρικές καταστάσεις θα πρέπει να συμβουλευτούν το γιατρό τους πριν από τη χρήση. Λάβετε υπόψη ότι η κατάλληλη χρήση των μασκών προσώπου LED μπορεί ενδεχομένως να οδηγήσει σε σκούρο δέρμα ή άλλα προβλήματα. Τα άτομα που χρησιμοποιούν ειδικά ιατρικά εμφυτεύματα, μόνιτορ καρδιακού ρυθμού ή έχουν ειδικές ιατρικές παθήσεις, πληγές στο πρόσωπο ή φωτοευαισθησία θα πρέπει να συμβουλευτούν έναν γιατρό πριν από τη χρήση. Μην πετάτε την μπαταρία στη φωτιά και μην την αποσυρμαολογείτε υπό οποιαδήποτε συνθήκες. Αυτή η συσκευή συμμορφώνεται με το μέρος 15 των κανόνων της FCC. Η λειτουργία υπόκειται στις ακόλουθες δύο προϋποθέσεις: (1) η συσκευή αυτή δεν μπορεί να προκαλέσει επιβλαβείς παρεμβολές και (2) η συσκευή αυτή πρέπει να δέχεται κάθε παρεμβολή που δέχεται, συμπεριλαμβανομένων των παρεμβολών που μπορεί να προκαλέσουν ανεπιθύμητη λειτουργία.

**ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ: ΑΣΦΑΛΗΣ ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΜΠΑΤΑΡΙΩΝ** 1. Μην επιχειρήσετε να αποσυρμαολογήσετε ή να τροποποιήσετε την μπαταρία. Κάτι τέτοιο μπορεί να οδηγήσει σε διαρροή, πυρκαγιά ή έκρηξη και θα ακυρώσει την εγγύηση. Για τις χρησιμοποιημένες μπαταρίες θα πρέπει να ακολουθούνται οι κατάλληλες μέθοδοι απόρριψης και ανακύκλωσης. Ανατρέχετε πάντα στις οδηγίες του κατασκευαστή για τη φροντίδα και τη συντήρηση της μπαταρίας. 2. Μην αφήνετε την μπαταρία της συσκευής σας αχρησιμοποίητη για μεγάλα χρονικά διαστήματα. Για βέλτιστη υγεία της μπαταρίας, φορτίζετε την μπαταρία τουλάχιστον μία φορά κάθε τρεις μήνες. 3. Για να διατηρήσετε τη διάρκεια ζωής της μπαταρίας, βεβαιωθείτε ότι η συσκευή φορτίζεται μέσα σε εύλογο χρονικό διάστημα μετά τη χρήση. Ένας υπερβολικός χρόνος εκφόρτισης μπορεί να επηρεάσει αρνητικά την απόδοση της μπαταρίας. 4. Αποφύγετε τη μακροχρόνια αποθήκευση της συσκευής με άδεια μπαταρία. Φορτίστε την μπαταρία σε ποσοστό τουλάχιστον 50% πριν την αποθήκευση για μεγάλο χρονικό διάστημα για να αποφύγετε μόνιμη βλάβη.

**ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ CE** Η NanoGrid Limited (Nanoleaf®) δηλώνει ότι η παρούσα συσκευή συμμορφώνεται με τις βασικές απαιτήσεις και άλλες σχετικές διατάξεις της οδηγίας 2014/53/ΕΕ. Η δήλωση συμμόρφωσης είναι διαθέσιμη στη διεύθυνση <https://nanoleaf.me/eudocs>. **ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ** – Μην καθαρίζετε τη συσκευή με υγρό ή σπρέι όταν είναι συνδεδεμένη στο ρεύμα. Καθαρίστε με ένα μαλακό, στεγνό πανί και μην χρησιμοποιείτε ισχυρά καθαριστικά.

**ΠΑΗΡΟΦΟΡΪΕΣ ΕΓΓΥΨΗΣΗΣ** Αυτό το προϊόν έχει εγγύηση ενός έτους από την ημερομηνία αγοράς. Οι ζημιές που προκαλούνται από το χρόνο και τη χρήση δεν εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής της εγγύησης σέρβις. Το πεδίο εφαρμογής της εγγύησης αυτού του προϊόντος δεν περιλαμβάνει βλάβες που οφείλονται σε άλλους παράγοντες εκτός από τα ελαττώματα του ίδιου του προϊόντος.



Απόρριψη του παλιού σας προϊόντος: Το προϊόν σας έχει σχεδιαστεί και κατασκευαστεί με υλικά και εξαρτήματα υψηλής ποιότητας, τα οποία μπορούν να ανακυκλωθούν και να επαναχρησιμοποιηθούν. Όταν αυτό το σύμβολο του διαγραμμένου κάδου απορριμμάτων είναι προσαρτημένο σε ένα προϊόν, σημαίνει ότι το προϊόν καλύπτεται από την ευρωπαϊκή οδηγία 2012/19/ΕΕ. Ενημερωθείτε για το τοπικό σας σύστημα συλλογής ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών προϊόντων. Ενεργήστε σύμφωνα με τους τοπικούς σας κανόνες και μην πετάτε τα παλιά σας προϊόντα μαζί με τα συνηθισμένα οικιακά απορρίμματα. Η σωστή απόρριψη του παλιού σας προϊόντος θα βοηθήσει στην αποφυγή πιθανών αρνητικών συνεπειών για το περιβάλλον και την ανθρώπινη υγεία.

**ET LED-VALGUSTERAAPIA NÄOMASK** – Kiirkäivitatamise juhend. **MIDA LEIATE KARBI SEEST?** See seade on laetav ja kaasaskantav ning seda saab kasutada ilma vooluvõrku ühendamata. **Komplekt sisaldab:** silikoonist LED-näomask, silmakaitsemed (1 paar), juhtpult, laadimiskaabel (USB A-C), takjapaelad (1 paar). **JUHTIMINE:** (A) Toitenupp – Hoidke all 2 sekundit, et sisse/välja lülitada. Seade lülitub vaikimisi välja pärast 10 minutit, kuid ajatimeri peatamiseks vajutage uuesti. (B) Režiimi valik – Vajutage üks kord, et valida punane, roheline, sinine, lilla, tsüaan, kollane või valge valgusravi režiim. Iga valgus sisaldab ka lähiinfrapunavalgust (NIR) paremate tulemuste saavutamiseks. Ekraan kuvab vastava valgusrežiimi. Vajutage kiiresti kaks korda, et reguleerida intensiivsust 5 tasemel. (C) Taimer – Vajutage üks kord, et lisada 1 minut, või hoidke all, et suurendada aega kuni 30 minutini. Seade lülitub välja, kui taimer saab täis. **VALGUSTERAAPIA REŽIIMID:** Kõik valgusrežiimid sisaldavad 850 nm NIR-valgust. Punane valgus (640nm + 850nm) – Soodustab rakkude aktiivsust, stimuleerib kollageeni tootmist, parandab naha elastsust ja vähendab kortse. Sinine valgus (460nm + 850nm) – Antibakteriaalne ja põletikuvastane toime, aitab vähendada aknet ja taastada nahka. Roheline valgus (525nm + 850nm) – Soodustab rakuenergia tootmist, ühtlustab nahatooni ning vähendab punetust ja pigmentatsiooni. Tsüaanvalgus (460nm + 525nm + 850nm) – Rahustab ja taastab ärritunud nahka, vähendab põletikke. Kollane valgus (640nm + 525nm + 850nm) – Toetab kudede paranemist, aitab roosatsea ja punetuse vastu ning parandab naha üldist toonust. Lilla valgus (640nm + 460nm + 850nm) – Mitmesageduslik ravi, mis sihib aknet ja aknearme. Valge valgus (640nm + 525nm + 460nm + 850nm) – Tungib sügavamale, kiirendab naha ainevahetust ja parandab toitainete imendumist. **SILMAKAITSEME PAIGALDAMINE:** Asetage kaitsemed õrnalt maski siseküljele. **RIHMAD KINNITAMINE:** Asetage rihmad ja kinnitage takjapaelaga. **LAADIMINE:** Hoiatus! Seade ei ole meditsiiniline toode ja ei asenda professionaalset ravi. Ärge kasutage seadet laadimise ajal. Kui see muutub liiga kuumaks, hakkab suitsu eritama või lõhnab ebatavaliselt, katkestage laadimine ja võtke ühendust klienditeenindusega. Laadige seadet USB-C kaabliga, ühendades USB-A otsa toiteallikasse. Ekraanil vilkuv akuikoon näitab laadimist, täielik laadimine (0–100%) kestab umbes 3,5 tundi. **KASUTUSJUHE:** 1. Puhastage ja kuivatage oma nägu. 2. Ühendage LED-mask juhtpuldiga. 3. Vajutage toitenuppu sisselülitamiseks. 4. Valige valgusravi režiim. 5. Reguleerige taimerit (soovitav 10–15 minutit, maksimaalselt 30 minutit). 6. Vajutage kiiresti kaks korda, et kohandada valguse tugevust. 7. Seade on kaasaskantav ja ei vaja töötamiseks vooluühendust. 8. Kui sessioon lõpeb, pühkige mask pehme lapiga. **ETTEVAATUSABINÕUD:** 1. Ärge vaadake otse LED-tulesid. 2. Hoidke silmad suletuna – see on ideaalne hetk lõõgastumiseks! 3. Ärge painutage ega suruge maski. 4. Puhastamisel ärge leotage vees, vaid pühkige niiske lapiga või 70% alkoholiga. Takjarihmad võib pesta veega.

**HOIATUSED** See toode sisaldab infrapunakiirgust. Ärge kasutage seda seadet rohkem kui 30 minutit korraga. Rasedad naised, lapsed, epilepsiahaiged, kilpnäärmehaiged või kilpnäärmeravimeid tarvitavad isikud ei tohi seda toodet kasutada. Ärge kasutage fotoallergiate korral ega ravimite võtmise ajal, mis võivad põhjustada fotoallergiat või valgustundlikkust. Vältige haavu ja nahatraumadega piirkondi. Isikud, kellel on meditsiinilised implantaadid, pulsimõõturid või erilised meditsiinilised seisundid, peaksid enne kasutamist konsulteerima arstiga. Pange tähele, et LED-näomaskide ebaõige kasutamine võib potentsiaalselt põhjustada naha tumenemist või muid probleeme. Isikud, kellel on meditsiinilised implantaadid, pulsimõõturid, erilised meditsiinilised seisundid, näohaavad või valgustundlikkus, peaksid enne kasutamist konsulteerima arstiga. Ärge visake akut tulle ega demonteerige seda mingil tingimusel. See seade vastab FCC määruste 15. osale. Kasutamine sõltub järgmistest kahest tingimusest: (1) see seade ei tohi põhjustada kahjulikku häiret ning (2) see seade peab vastu võtma kõik saadud häired, sealhulgas häired, mis võivad põhjustada soovimatut töörežiimi.

**HOIATUSED: PATAREIDE OHUTU KASUTAMINE** 1. Ärge proovige akut lahti võtta ega muuta. See võib põhjustada lekkeid, tulekahju või plahvatust ning tühistab garantii. Kasutatud patareide puhul tuleb järgida nõuetekohaseid kõrvaldamis- ja ringlussevõtumetodeid. Alati tuleb järgida tootja juhiseid aku hoolduse ja kasutamise kohta. 2. Ärge jätke seadme akut pikaks ajaks kasutamata. Aku tervise säilitamiseks laadige akut vähemalt kord kolme kuu jooksul. 3. Aku eluea säilitamiseks veenduge, et seadet laetaks mõistliku aja jooksul pärast kasutamist. Liigne tühjenemisaeg võib aku jõudlust negatiivselt mõjutada. 4. Vältige seadme pikaajalist hoiustamist tühjenenud akuga. Aku püsiva kahjustuse vältimiseks laadige see enne pikemaajaliseks hoiustamiseks vähemalt 50%-ni.

**CE TEAVE** NanoGrid Limited (Nanoleaf®) kinnitab käesolevaga, et see seade vastab direktiivi 2014/53/EL olulistele nõuetele ja muudele asjakohastele sätetele. Vastavusdeklaratsioon on saadaval aadressil <https://nanoleaf.me/eudocs>. **PUHASTAMINE JA HOOLDUS** - Ärge puhastage seadet vedelike või pihustitega, kui see on ühendatud vooluvõrku. Puhastage pehme kuiva lapiga ja ärge kasutage tugevaid puhastusvahendeid.

**GARANTII TEAVE** Sellel tootel on üheaastane garantii alates ostukuupäevast. Aja jooksul ja kasutamise käigus tekkinud kahjustused ei kuulu teenindusgarantii alla. Selle toote garantii ei kata rikkeid, mis on põhjustatud muudest teguritest kui toote enda vead.



Teie toode on disainitud ja valmistatud kvaliteetsetest materjalidest ja komponentidest, mida saab taaskasutada ja ümber töödelda. Kui tootele on lisatud see läbikiipsutatud ratastega prügikasti sümbol, tähendab see, et toode kuulub Euroopa direktiivi 2012/19/EL alla. Palun uurige oma kohaliku elektri- ja elektroonikaseadmete kogumissüsteemi kohta. Järgige kohalikke eeskirju ning ärge visake oma vana toodet tavalise olmeprügi hulka. Toote nõuetekohane kõrvaldamine aitab vältida võimalikke negatiivseid tagajärgi keskkonnale ja inimeste tervisele.

**FI LED-VALOTERAPIANAAMION PIKAOPAS. PAKKAUKSEN SISÄLTÖ:** Tämä laite on ladattava ja kannettava, eikä sitä tarvitse käyttää verkkovirrassa. Pakkaus sisältää: silikoninen LED-kasvonaamio, silmäsuojat (1 pari), ohjain, latauskaapeli (USB A-C) ja tarraauhahihnat (1 pari). **HALLINTA:** (A) Virtapainike – Pidä painettuna 2 sekuntia laitteen käynnistämiseksi/sammuttamiseksi. Oletuksena laite sammuu 10 minuutin kuluttua. Voit keskeyttää ajastimen painamalla virtapainiketta uudelleen. (B) Tilavalinta – Paina kerran vaihtaaksesi punaisen, vihreän, sinisen, violetin, syyaanin, keltaisen ja valkoisen valoterapiatilaa välillä. Jokainen tila sisältää myös lähi-infrapuna-valon (NIR) hoidon tehostamiseksi. Näytöllä näkyy valittu tila. Paina nopeasti kahdesti säätääksesi intensiteettiä 5 tasolla. (C) Ajastin – Paina kerran lisätäksesi 1 minuutin, tai pidä painettuna lisätäksesi aikaa nopeasti enintään 30 minuuttiin. Laite sammuu automaattisesti, kun aika on täynnä. **VALOTERAPIATILAT:** Jokainen tila sisältää 850 nm NIR-valon. Punainen valo (640nm + 850nm) – Lisää solutoimintaa, edistää kollageenin muodostumista, parantaa ihon kimmoisuutta ja vähentää ryppyjä. Sininen valo (460nm + 850nm) – Antibakteerinen ja tulehdusta ehkäisevä, auttaa vähentämään aknea ja korjaamaan ihoa. Vihreä valo (525nm + 850nm) – Stimuloi solujen energiaa, tasoiittaa ihonsävyä ja vähentää punoitusta sekä hyperpigmentaatiota. Syaani valo (460nm + 525nm + 850nm) – Rauhoittaa ja lievittää ärtynyttä ihoa sekä hoitaa tulehduksia. Keltainen valo (640nm + 525nm + 850nm) – Edistää kudosten paranemista, auttaa ruusuönnin hoidossa, vähentää punoitusta ja parantaa ihon yleistä sävyä. Violetti valo (640nm + 460nm + 850nm) – Monitaajuushoito, joka kohdistuu akneen ja aknearpien hoitoon. Valkoinen valo (640nm + 525nm + 460nm + 850nm) – Tunkeutuu syvälle ihoon, nopeuttaa aineenvaihduntaa ja parantaa ravinteiden imeytymistä. **SILMÄSUOJIEEN ASENTAMINEN:** Aseta silmäsuojat varovasti sisäpuolelle. **HIHNOJEN KIINNITYS:** Kiinnitä hihnat ja säädä ne tarraauhalla. **LAITTEEN LATAAMINEN:** Varoitus! Tämä ei ole lääketieteellinen laite eikä korvaa ammattilaisen hoitoa. Käytön vaikutukset vaihtelevat henkilöittäin. Älä käytä laitetta latauksen aikana. Jos laite kuumenee liikaa, tuottaa savua tai epätavallista hajua, irrota laturi välittömästi ja ota yhteyttä asiakaspalveluun. Lataa laite liitännällä USB-C-kaapeli ohjaimeen ja USB-A-pää virtalähteeseen. Vilkkuva akun kuvake osoittaa latauksen olevan käynnissä. Täyteen lataaminen kestää noin 3,5 tuntia. **KÄYTTÖOHJE:** 1. Puhdista ja kuivaa kasvot ennen käyttöä. 2. Kytke LED-kasvonaamio ohjaimeen. 3. Paina virtapainiketta laitteen käynnistämiseksi. 4. Valitse haluamasi valoterapia. 5. Säädä ajastinta (suositus 10–15 minuuttia, enintään 30 minuuttia). 6. Paina tilapainiketta nopeasti kahdesti säätääksesi valon voimakkuutta. 7. Laite on kannettava eikä vaadi verkkovirtaa käytön aikana. 8. Hoitojakson päätyttyä pyyhi naamio pehmeällä liinalla. **VAROITIMET:** 1. Vältä katsomasta suoraan LED-valoihin. 2. Pidä silmät suljettuina käytön aikana – tämä on hyvä hetki rentoutua! 3. Älä taita, purista tai paina maskia. 4. Puhdista maski kostealla liinalla, älä upota veteen. Syväpuhdistukseen käytä 70 % alkoholia. Tarraauhat voidaan pestä vedellä.

**VAROITUKSET** Tämä tuote sisältää infrapunaspektrin. Älä käytä tätä laitetta yli 30 minuuttia kerrallaan. Raskaana olevat naiset, lapset, epilepsiapotilaat, kilpirauhaspotilaat tai kilpirauhaslääkitystä käyttävät henkilöt eivät saa käyttää tätä tuotetta. Älä käytä, jos sinulla on valoallergia tai jos käytät lääkkeitä, jotka voivat aiheuttaa valoallergiaa tai valoherkkyyttä. Vältä haavoja ja ihovaurioita, joissa on vaurioita. Henkilöiden, joilla on lääketieteellisiä implantteja, sykemittareita tai erityisiä terveydentiloja, tulisi neuvotella lääkärin kanssa ennen käyttöä. Vältä lääkärin kanssa ennen käyttöä. Älä hävitä akkua tuleen äläkä pura sitä missään olosuhteissa. Tämä laite noudattaa FCC-sääntöjen osaa 15. Käyttö on seuraavien kahden ehdon alaisista: (1) tämä laite ei saa aiheuttaa haitallisia häiriöitä, ja (2) tämän laitteen on hyväksyttävä kaikki vastaanotetut häiriöt, mukaan lukien häiriöt, jotka voivat aiheuttaa ei-toivottua toimintaa.

**VAROITUKSET: AKKUJEN TURVALLINEN KÄYTTÖ** 1. Älä yritä purkaa tai muokata akkua. Tämä voi aiheuttaa vuotoja, tulipalon tai räjähdysten ja mitätöi takuun. Käytetyille akuille on noudatettava asianmukaisia hävittämisen- ja kierrätysmenetelmiä. Katso aina valmistajan ohjeet akun huoltoon ja ylläpitoon. 2. Älä jätä laitteen akkua käyttämättömäksi pitkäksi aikaa. Akun terveyden säilyttämiseksi lataa akku vähintään kerran kolmessa kuukaudessa. 3. Akun käyttöä ylläpitämiseksi varmista, että laite ladataan kohtuullisessa ajassa käytön jälkeen. Liian pitkä purkautumisaika voi heikentää akun suorituskykyä. 4. Vältä laitteen pitkäaikaista säilytystä tyhjentyneellä akulla. Lataa akku vähintään 50 %:iin ennen pitkää säilytystä pysyvien vaurioiden estämiseksi.

**CE-TIEDOT** NanoGrid Limited (Nanoleaf®) ilmoittaa täten, että tämä laite on direktiivin 2014/53/EU olennaisten vaatimusten ja muiden asiaankuuluvien säännösten mukainen. Vaatimustenmukaisuusvakuutus on saatavilla osoitteessa <https://nanoleaf.me/eudocs>. **PUHDISTUS JA HUOLTO** - Älä puhdista laitetta nesteillä tai suihkeilla, kun se on kytketty nä virtalähteeseen. Puhdista pehmeällä kuivalla liinalla äläkä käytä voimakkaita puhdistusaineita.

**TAKUUTIEDOT** Tällä tuotteella on yhden vuoden takuu ostopäivästä lähtien. Ajankulun ja käytön aiheuttamat vahingot eivät kuulu palvelutakuun piiriin. Tämän tuotteen takuu ei kata vikoja, jotka johtuvat muista tekijöistä kuin itse tuotteen vioista.



Vanhan tuotteen hävittäminen: Tuotteenne on suunniteltu ja valmistettu korkealaatuista materiaaleista ja komponenteista, jotka voidaan kierrättää ja uudelleenkäyttää. Kun tämä yliviivattu roskakorin symboli on kiinnitetty tuotteeseen, se tarkoittaa, että tuote kuuluu Euroopan unionin direktiivin 2012/19/EU piiriin. Tutustu paikalliseen sähköisten ja elektronisten laitteiden keräysjärjestelmään. Noudata paikallisia sääntöjä äläkä hävitä vanhoja tuotteita yhdessä normaalin kotitalousjätteen kanssa. Oikea vanhan tuotteen hävittäminen auttaa ehkäisemään mahdollisia haitallisia vaikutuksia ympäristölle ja terveydelle.

**HR LED MASKA ZA SVJETLOSNU TERAPIJU** – BRZI VODIČ. **ŠTO JE U KUTIJI?** Ovaj uređaj je punjiv i prenosiv te se može koristiti bez priključivanja na utičnicu. Uključuje: silikonsku LED masku za lice, zaštitnike za očne duplje (1 par), kontroler, punjač (USB A na C) i traku na čičak (1 par). **UPRAVLJANJE:** (A) Gumb za napajanje – Držite pritisnuto 2 sekunde za uključivanje/isključivanje. Uređaj je podešen da se automatski isključi nakon 10 minuta. Ponovno pritisnite gumb za pauziranje timera. (B) Odabir moda – Pritisnite jednom za prebacivanje između crvene, zelene, plave, ljubičaste, cijan, žute i bijele svjetlosne terapije. Svaki mod uključuje blisko infracrveno svjetlo (NIR) za poboljšanje učinka tretmana. Zaslon prikazuje odabrani mod. Brzo pritisnite dvaput za podešavanje intenziteta na 5 razina. (C) Timer – Pritisnite jednom za dodavanje 1 minute, ili držite pritisnuto za brzo dodavanje do maksimalno 30 minuta. Uređaj će se automatski isključiti kada istekne vrijeme. **MODOVI SVJETLOSNE TERAPIJE:** Svaki mod uključuje NIR svjetlo od 850 nm za poboljšanje tretmana. Crveno svjetlo (640nm + 850nm) – Povećava aktivnost stanica, potiče proizvodnju kolagena, poboljšava elastičnost kože i smanjuje bore. Plavo svjetlo (460nm + 850nm) – Antibakterijsko i protuupalno djelovanje pomaže u smanjenju akni i obnavljanju kože. Zeleno svjetlo (525nm + 850nm) – Potiče energiju stanica, ujednačava ton kože i smanjuje crvenilo te hiperpigmentaciju. Cijan svjetlo (460nm + 525nm + 850nm) – Umiruje osjetljivu kožu, potiče zacjeljivanje i smanjuje upale. Žuto svjetlo (640nm + 525nm + 850nm) – Potiče regeneraciju tkiva, pomaže u liječenju rozaceje i poboljšava ton kože. Ljubičasto svjetlo (640nm + 460nm + 850nm) – Cilja na akne i ožiljke od akni pomoću višefrekventnog tretmana. Bijelo svjetlo (640nm + 525nm + 460nm + 850nm) – Prodire dublje u kožu, ubrzava metabolizam i poboljšava apsorpciju hranjivih tvari. **POSTAVLJANJE ZAŠTITE ZA OČI:** Nježno umetnite

zaštitnike iznutra. **PRIČVRŠČIVANJE TRAKA:** Umetnite trake i pričvrstite čičak zatvaračem. **PUNJENJE UREĐAJA:** Upozorenje! Ovo nije medicinski uređaj i ne može zamijeniti stručni tretman. Učinci korištenja variraju od osobe do osobe. Ne koristite uređaj tijekom punjenja. Ako se uređaj pregrijava, ispušta dim ili neobične mirise, odmah ga odspojite i kontaktirajte korisničku podršku. Punitite uređaj spajanjem USB-C kabela na kontroler i USB-A kraja u izvor napajanja. Ikona baterije koja treperi označava punjenje. Punjenje od 0% do 100% traje približno 3,5 sata. **KAKO KORISTITI:** 1. Očistite i osušite lice prije korištenja. 2. Spojite LED masku na kontroler. 3. Pritisnite gumb za napajanje za uključivanje uređaja. 4. Odaberite željeni mod svjetlosne terapije. 5. Podesite trajanje tretmana pomoću timera (preporučeno 10–15 min, najviše 30 min). 6. Brzo dvaput pritisnite gumb za mod kako biste podesili jačinu svjetla. 7. Uređaj je prijenosan i ne mora biti spojen na struju tijekom korištenja. 8. Nakon završetka tretmana, obrišite masku mekom krpom. **PRECAUCIJE:** 1. Ne gledajte izravno u LED svjetla. 2. Tijekom korištenja držite oči zatvorene – idealno vrijeme za opuštanje! 3. Nemojte savijati, pritiskati ili stiskati masku. 4. Očistite masku vlažnom krpom, ne uranjajte je u vodu. Za dublje čišćenje koristite 70% alkohol. Elastične trake mogu se prati vodom.

**UPOZORENJA** Ovaj proizvod sadrži infracrveni spektar. Nemojte koristiti ovaj uređaj duže od 30 minuta u kontinuitetu. Trudnice, djeca, osobe s epilepsijom, pacijenti s problemima štitnjače ili oni koji uzimaju lijekove za štitnjaču ne bi trebali koristiti ovaj proizvod. Nemojte koristiti ako imate fotoalergije ili ako uzimate lijekove koji mogu uzrokovati fotoalergije ili fotosenzitivnost. Izbjegavajte rane i područja s kožnim ozljedama. Osobe koje koriste posebne medicinske implantate, monitore otkucaja srca ili imaju posebna medicinska stanja trebale bi se posavjetovati s liječnikom prije uporabe. Imajte na umu da nepravilna uporaba LED maski za lice može dovesti do potamnjenja kože ili drugih problema. Osobe koje koriste posebne medicinske implantate, monitore otkucaja srca ili imaju posebna medicinska stanja, ozljede lica ili fotosenzitivnost trebale bi se posavjetovati s liječnikom prije uporabe. Nemojte bacati bateriju u vatru niti je rastavljati pod bilo kojim uvjetima. Ovaj uređaj je u skladu s Dijelom 15 FCC pravila. Rad uređaja podliježe sljedećim uvjetima: (1) ovaj uređaj ne smije uzrokovati štetne smetnje i (2) ovaj uređaj mora prihvatiti bilo kakve primljene smetnje, uključujući smetnje koje mogu uzrokovati neželjeni rad.

**UPOZORENJA: SIGURNA UPOTREBA BATERIJA** 1. Nemojte pokušavati rastavljati ili modificirati bateriju. To može dovesti do curenja, požara ili eksplozije i poništiti jamstvo. Pravilne metode odlaganja i reciklaže treba slijediti za iskorištene baterije. Uvijek se pridržavajte smjernica proizvođača za održavanje i brigu o bateriji. 2. Nemojte ostavljati bateriju uređaja neiskorištenu tijekom duljeg vremenskog razdoblja. Za optimalno zdravlje baterije, napunite je barem jednom svaka tri mjeseca. 3. Kako biste održali vijek trajanja baterije, osigurajte da se uređaj napuni u razumnom vremenu nakon upotrebe. Pretjerano pražnjenje može negativno utjecati na performanse baterije. 4. Izbjegavajte dugotrajno skladištenje uređaja s potpuno ispražnjenom baterijom. Prije dugotrajnog skladištenja napunite bateriju do najmanje 50% kako biste spriječili trajna oštećenja.

**CE INFORMACIJE** NanoGrid Limited (Nanoleaf®) ovime izjavljuje da je ovaj uređaj u skladu s osnovnim zahtjevima i drugim relevantnim odredbama Direktive 2014/53/EU. Izjava o sukladnosti dostupna je na <https://nanoleaf.me/eudocs>. **ČIŠĆENJE I ODRŽAVANJE** - Ne čistite uređaj tekućinama ili sprejevima dok je priključen na struju. Očistite ga mekom suhom krpom i nemojte koristiti agresivna sredstva za čišćenje.

**INFORMACIJE O JAMSTVU** Ovaj proizvod ima jednogodišnje jamstvo od datuma kupnje. Oštećenja uzrokovana vremenom i upotrebom nisu obuhvaćena jamstvenim servisom. Jamstvo ovog proizvoda ne pokriva kvarove uzrokovane bilo kojim čimbenicima osim nedostacima samog proizvoda.



Zbrinjavanje vašeg starog proizvoda: Vaš proizvod je dizajniran i proizveden od visokokvalitetnih materijala i komponenti, koje se mogu reciklirati i ponovo upotrijebiti. Kada je simbol precrtane kante za otpad pričvršćen na proizvod, to znači da je proizvod obuhvaćen europskom Direktivom 2012/19/EU. Informirajte se o lokalnom sustavu prikupljanja električnih i elektroničkih proizvoda. Postupajte u skladu s lokalnim propisima i ne odlazite stare proizvode s uobičajenim kućnim otpadom. Ispravno zbrinjavanje vašeg starog proizvoda pomaže u sprječavanju mogućih negativnih posljedica po okoliš i ljudsko zdravlje.

**HU LED FÉNYTERÁPIÁS ARCMASZK** – GYORSINDÍTÁSI ÚTMUTATÓ MI VAN A DOBOZBAN? Ez a készülék újratölthető és hordozható, így használatához anélkül, hogy konnektorba lenne csatlakoztatva. **Tartalmaz:** szilikon LED arcmaszkot, szemvédő betéteket (1 pár), vezérlőt, töltőkábelt (USB A-C), és tépőzáras pántot (1 pár). **VEZÉRLÉS:** (A) Bekapcsológomb – Nyomja meg és tartsa lenyomva 2 másodpercig a be- vagy kikapcsoláshoz. Az alapértelmezett automatikus kikapcsolási idő 10 perc. Nyomja meg újra a bekapcsológombot a visszaszámláló

szüneteltetéséhez. (B) Módváltasztás – Nyomja meg egyszer a piros, zöld, kék, lila, cián, sárga és fehér fényterápia közötti váltáshoz. Minden fény NIR (közeli infravörös) fénnel kombinálva fokozza a kezelési hatást. A kijelző mutatja az aktuális módot. Kétszeri gyors megnyomással 5 intenzitási szint között válthat. (C) Időzítő – Nyomja meg egyszer az időtartam percenkénti növeléséhez, vagy tartsa lenyomva a gyors hozzáadáshoz, maximum 30 percig. Az eszköz automatikusan kikapcsol, ha lejár az idő. **FÉNYTERÁPIÁS MÓDOK:** Minden mód tartalmaz 850 nm-es NIR fényt a hatás növelése érdekében. Piros fény (640nm + 850nm) – Serkenti a sejtműködést, elősegíti a kollagéntermelést, javítja a bőr rugalmasságát és csökkenti a ráncokat. Kék fény (460nm + 850nm) – Antibakteriális és gyulladáscsökkentő hatású, segít csökkenteni a pattanásokat és regenerálni a bőrt. Zöld fény (525nm + 850nm) – Stimulálja a sejtek energiáját, egyenletesebb bőrtónust biztosít, csökkenti a vörösséget és a hiperpigmentációt. Cián fény (460nm + 525nm + 850nm) – Nyugtatója az irritált bőrt, elősegíti a gyógyulást és csökkenti a gyulladást. Sárga fény (640nm + 525nm + 850nm) – Serkenti a szövetek regenerálódását, segíti a rosacea kezelését és javítja a bőr tónusát. Lila fény (640nm + 460nm + 850nm) – Többszintű kezelés pattanások és hegek ellen. Fehér fény (640nm + 525nm + 460nm + 850nm) – Mélyebben hatol be a bőrbe, felgyorsítja az anyagcserét és fokozza a tápanyagok felszívódását. **SEMVÉDŐ BETÉT FELHELYEZÉSE:** Helyezze be a belső oldalról. **PÁNTOK RÖGZÍTÉSE:** Illesse be és rögzítse a tépőzárral. **TÖLTÉS:** Figyelem! Ez nem orvostechnikai eszköz, és nem helyettesíti a szakmai kezelést. A hatás személyenként eltérő lehet. Ne használja töltés közben. Ha a készülék túlmelegszik, füstöl vagy szokatlan szagot áraszt, azonnal húzza ki és lépjen kapcsolatba az ügyfélszolgálatl. A töltéshez csatlakoztassa az USB-C kábelt a vezérlőhöz, majd az USB-A végét a töltőhöz. A villogó akkumulátor ikon jelzi a töltést, a folyamatosan világító ikon pedig a teljes töltöttséget. A teljes feltöltés kb. 3,5 órát vesz igénybe. **HASZNÁLAT:** 1. Tisztítsa és szárítsa meg az arcát. 2. Csatlakoztassa a LED maszkot a vezérlőhöz. 3. Nyomja meg a bekapcsológombot. 4. Válassza ki a kívánt fényterápiás módot. 5. Állítsa be az időtartamot (ajánlott 10-15 perc, max. 30 perc). 6. Kétszeri gyors megnyomással módosítsa a fény erősségét. 7. A készülék hordozható, nem szükséges folyamatosan áramforrás. 8. A kezelés után törölje le a maszkot puha törölkendővel. **ÖVINTÉZKEDÉSEK:** 1. Ne nézzen közvetlenül a LED fényekbe. 2. Használat közben tartsa csukva a szemét – tökéletes idő a pihenésre! 3. Ne hajlítsa, nyomja vagy préselje össze a maszkot. 4. Tisztításkor ne merítse vízbe, csak nedves ruhával törölje le. Alaposabb tisztításhoz használjon 70%-os alkoholt. A rugalmas pántok vízben moshatók.

**FIGYELMEZTETÉSEK** Ez a termék infravörös spektrumot tartalmaz. Ne használja ezt a készüléket 30 percnél hosszabb ideig egy alkalommal. Terhes nők, gyermekek, epilepsiában szenvedők, pajzsmirigy-betegség vagy pajzsmirigy-gyógyszert szedők ne használják ezt a terméket. Ne használja fotoallergia esetén, vagy ha olyan gyógyszereket szed, amelyek fotoallergiát vagy fényérzékenységet okozhatnak. Kerülje a sebeket és a sérült bőrfelületeket. Különleges orvosi implantátumokat használó személyek, pulzusmérő viselők vagy egyéb egészségügyi problémával rendelkező konzultáljanak orvosukkal a használat előtt. Kérjük, vegye figyelembe, hogy a LED arcmask helytelen használata bőr sötétedéséhez vagy más problémákhoz vezethet. Különleges orvosi implantátumokat használók, pulzusmérő viselők, egészségügyi problémákkal küzdők, arcsebekkel rendelkezők vagy fényérzékenyek konzultáljanak orvosukkal a használat előtt. Ne dobja a készülék akkumulátorát tűzbe, és semmilyen körülmények között ne szerelje szét. Ez a készülék megfelel az FCC 15. részének előírásainak. A működés az alábbi két feltételhez kötött: (1) ez a készülék nem okozhat káros interferenciát, és (2) ennek a készüléknek el kell fogadnia minden beérkező interferenciát, beleértve azokat is, amelyek nem kívánt működést eredményezhetnek.

**FIGYELMEZTETÉSEK: AZ AKKUMULÁTOR BIZTONSÁGOS HASZNÁLATA** 1. Ne próbálja meg szétszerelni vagy módosítani az akkumulátort. Ez szivárgást, tüzet vagy robbanást okozhat, és érvényteleníti a garanciát. A használt akkumulátorok megfelelő ártalmatlanítási és újrahasznosítási módszereit be kell tartani. Mindig kövesse a gyártó iránymutatásait az akkumulátor karbantartásával és kezelésével kapcsolatban. 2. Ne hagyja készüléke akkumulátorát hosszú ideig használaton kívül. Az akkumulátor optimális állapotának megőrzése érdekében legalább háromhavonta töltsse fel. 3. Az akkumulátor élettartamának megőrzése érdekében gondoskodjon róla, hogy a készülék használat után ésszerű időn belül feltöltésre kerüljön. A túlzott lemerülési idő károsan befolyásolhatja az akkumulátor teljesítményét. 4. Kerülje a készülék hosszú távú tárolását teljesen lemerült akkumulátorral. Az akkumulátort legalább 50%-os töltöttségre töltsse fel, mielőtt hosszabb ideig tárolná, hogy elkerülje a maradandó károsodást.

**CE INFORMÁCIÓ** A NanoGrid Limited (Nanoleaf®) ezúton kijelenti, hogy ez az eszköz megfelel a 2014/53/EU irányelv alapvető követelményeinek és egyéb vonatkozó rendelkezéseinek. A megfelelőségi nyilatkozat elérhető a következő weboldalon: <https://nanoleaf.me/eudocs>. **TISZTÍTÁS ÉS KARBANTARTÁS** - Ne tisztítsa a készüléket folyadékokkal vagy permetekkel,

amig az áram alatt van. Tisztítsa puha, száraz ruhával, és ne használjon erős tisztítószereket.

**GARANCIA INFORMÁCIÓK** Ez a termék egyéves garanciával rendelkezik a vásárlás dátumától számítva. Az idő múlásából és a használatból eredő károk nem tartoznak a garanciális szolgáltatás körébe. A garancia nem vonatkozik olyan meghibásodásokra, amelyek nem a termék saját hibájából adódnak.



Régi termékének ártalmatlanítása: Terméke kiváló minőségű anyagokból és alkatrészekből készül, amelyek újrahasznosíthatók és újrafelhasználhatók. Ha egy terméken áthúzott koca szimbólum található, az azt jelenti, hogy az a 2012/19/EU európai irányelv hatálya alá tartozik. Kérjük, tájékozódjon a helyi elektromos és elektronikus termékek gyűjtési rendszeréről. Tartsa be a helyi előírásokat, és ne dobja ki régi termékeit a háztartási hulladékkal együtt. A megfelelő ártalmatlanítás segít megelőzni a környezetre és az emberi egészségre gyakorolt esetleges káros hatásokat.

**LT LED ŠVIESOS TERAPIJOS VEIDO KAUKĖ** – GREITO PRADŽIOS VADOVAS KAS YRA DĖŽUTĖJE? Šis įrenginys yra įkraunamas ir nešiojamas, todėl jį galima naudoti be tiesioginio prijungimo prie elektros lizdo. Komplekte yra silikoninė LED veido kaukė, akių apsaugos (1 pora), valdiklis, įkrovimo laidas (USB A–C) ir Velcro dirželiai (1 pora). **VALDYMAS:** (A) Maitinimo mygtukas – Paspauskite ir laikykite 2 sek. įjungimui/išjungimui. Įrenginys pagal numatytuosius nustatymus išsijungia po 10 minučių. Dar kartą paspaudus mygtuką, laikmatis sustabdomas. (B) Režimų pasirinkimas – Vieną kartą paspaudus, galima keisti šviesos terapijos režimus: raudoną, žalią, mėlyną, violetinį, žydrą, geltoną ir baltą. Visi režimai derinami su artimojo infraraudonųjų spindulių (NIR) šviesa, kad sustiprintų poveikį. Ekране rodomas pasirinktas režimas. Dukart greitai paspaudus, galima pasirinkti iš 5 intensyvumo lygių. (C) Laikmatis – Vieną paspaudimu pridedama 1 min., ilgai paspaudus laikas greičiau didėja iki 30 min. Pasibaigus laikui, įrenginys automatiškai išsijungia. **ŠVIESOS TERAPIJOS REŽIMAI:** Visi režimai turi 850 nm NIR spindulius, kad pagerintų gydymo poveikį. Raudona šviesa (640nm + 850nm) – Skatina ląstelių aktyvumą, kolageno gamybą, gerina odos elastingumą ir mažina raukšles. Mėlyna šviesa (460nm + 850nm) – Antibakterinis ir priešuždegiminis poveikis, padeda sumažinti spuogus ir odos pažeidimus. Žalia šviesa (525nm + 850nm) – Skatina ląstelių energijos gamybą, tolygina odos atspalvį, mažina paraudimą ir hiperpigmentaciją. Žydra šviesa (460nm + 525nm + 850nm) – Ramina jaučią, sudirgusią odą, skatina gijimą ir mažina uždegimą. Geltona šviesa (640nm + 525nm + 850nm) – Padeda gydyti rožinę, mažina paraudimą ir gerina odos atspalvį. Violetinė šviesa (640nm + 460nm + 850nm) – Daugiafunkcis gydymas nuo spuogų ir randų. Balta šviesa (640nm + 525nm + 460nm + 850nm) – Giliai prisiskverbia į odą, skatina medžiagų apykaitą ir gerina maistinių medžiagų įsisavinimą. **AKIŲ APSAUGŲ TVIRTINIMAS:** Įstatykite iš vidinės pusės. **DIRŽELIŲ PRITVIRTINIMAS:** Įkiškite ir sureguliuokite su Velcro užsegimu. **ĮKROVIMAS:** Įspėjimas! Tai nėra medicinos prietaisas ir nepakeičia profesionalaus gydymo. Poveikis gali skirtis priklausomai nuo asmens. Nenaudokite įrenginio įkrovimo metu. Jei įrenginys perkaista, skleidžia dūmus ar nemalonų kvapą, nedelsdami atjunkite jį nuo įkroviklio ir kreipkitės į klientų aptarnavimą. Įkraukite prijungdami USB-C laidą prie valdiklio ir USB-A galą į maitinimo šaltinį. Jei ekrane baterijos piktograma mirksi, įkrovimas vyksta, o kai ji dega nepertraukiamai, įrenginys pilnai įkrautas. Visiškai įkrovimas trunka apie 3,5 val. **KAIP NAUDOTI:** 1. Nuvalykite ir nusausinkite veidą. 2. Prijunkite LED kaukę prie valdiklio. 3. Paspauskite maitinimo mygtuką įjungimui. 4. Pasirinkite norimą šviesos terapijos režimą. 5. Paspauskite laikmatį, kad nustatytumėte seanso trukmę (rekomenduojama 10–15 min., bet ne ilgiau kaip 30 min.). 6. Dukart greitai paspauskite režimo mygtuką, kad sureguliuotumėte LED šviesos intensyvumą. 7. Įrenginys yra nešiojamas ir nereikalauja tiesioginio elektros tiekimo naudojimo metu. 8. Pasibaigus laikui, nuvalykite kaukę minkštu rankšluosčiu. Nemerkti į vandenį! **ATSARGUMO PRIEMONĖS:** 1. Nežiūrėkite tiesiai į LED šviesas. 2. Rekomenduojama naudoti užmerktomis akimis – tai puikus metas atsipalaiduoti! 3. Nesulenkite, nespauskite ir nesusukite kaukės. 4. Valydami kaukę, nenaudokite vandens – tik drėgną šluostę. Dėl gilesnio valymo švelniai nuvalykite 70% alkoholiu. Tamprius dirželiai gali būti plunami vandeniui.

**ISPĖJIMAI** Šis produktas skleidžia infraraudonųjų spindulių. Nenaudokite šio prietaiso ilgiau nei 30 minučių vienu metu. Nėščios moterys, vaikai, epilepsija sergantys asmenys, skydliaukės ligomis sergantys ar skydliaukės vaistus vartojantys asmenys neturėtų naudoti šio produkto. Nenaudokite esant fotoalergijai arba vartojant vaistus, galinčius sukelti fotoalergiją ar fotosensibilizaciją. Venkite naudoti ant žaizdų ar pažeistos odos vietų. Asmenys, turintys specialių medicininių implantų, naudojančius širdies ritmo matuoklius arba turintys specialių sveikatos būklių, prieš naudodami turėtų pasitarti su gydytoju. Atkreipkite dėmesį, kad netinkamas LED veido kaukių naudojimas gali sukelti odos patamsėjimą ar kitas problemas. Asmenys, turintys specialių medicininių implantų, naudojančius širdies ritmo matuoklius arba turintys specialių sveikatos būklių, veido žaizdų ar fotosensibilizaciją, prieš

naudodami turėtų pasitarti su gydytoju. Nedeginkite baterijos ir jokiu būdu jos nedemontuokite. Šis įrenginys atitinka FCC taisyklių 15 dalį. Jo veikimas priklauso nuo šių dviejų sąlygų: (1) šis įrenginys negali sukelti žalingų trukdžių, ir (2) šis įrenginys turi priimti bet kokius gautus trukdžius, įskaitant trukdžius, galinčius sukelti nepageidaujamą veikimą.

**ĮSPĖJIMAI: SAUGUS BATERIJŲ NAUDOJIMAS** 1. Nebandykite išardyti ar modifikuoti baterijos. Tai gali sukelti nuotėkį, gaisrą ar sprogingą ir panaikins garantiją. Naudotas baterijas būtina tinkamai utilizuoti ir perdirbti. Visada laikykitės gamintojo nurodymų dėl baterijos priežiūros ir naudojimo. 2. Nenaudojamos baterijos neturėtų būti laikomos ilgą laiką. Norint išlaikyti baterijos sveikatą, įkraukite ją bent kartą per tris mėnesius. 3. Kad išlaikytumėte baterijos ilgaamžiškumą, užtikrinkite, kad prietaisas būtų įkrautas per pagrįstą laikotarpį po naudojimo. Per ilgą išsikrovimo laiką gali neigiamai paveikti baterijos veikimą. 4. Nelaikykite prietaiso ilgą laiką su visiškai išsikrovusia baterija. Prieš ilgesnį saugojimą įkraukite bateriją bent iki 50 %, kad išvengtumėte negrįžtamos žalos.

**CE INFORMACIJA** „NanoGrid Limited“ (Nanoleaf®) pareiškia, kad šis įrenginys atitinka esminius 2014/53/ES direktyvos reikalavimus ir kitas susijusias nuostatas. Atitiktis deklaraciją galima rasti adresu: <http://nanoleaf.me/eudocs>. **VALYMAS IR PRIEŽIŪRA** – Nevalykite prietaiso skysčiais ar purškikliais, kai jis prijungtas prie elektros tinklo. Valykite minkšta sausa šluoste ir nenaudokite agresyvių valiklių.

**GARANTIJOS INFORMACIJA** Šiam produktui suteikiama vienerių metų garantija nuo pirkimo datos. Žala, atsiradusi dėl naudojimo ar laiko poveikio, nepatenka į paslaugų garantijos taikymo sritį. Šio produkto garantija neapima gedimų, kuriuos sukėlė bet kokie veiksniai, išskyrus paties produkto defektus.



Jūsų senojo gaminio utilizavimas: Jūsų gaminyje buvo sukurtas ir pagamintas naudojant aukštos kokybės medžiagas ir komponentus, kurie gali būti perdirbami ir pakartotinai naudojami. Jei ant gaminio yra perbrauktas šiukšliadėžės simbolis, tai reiškia, kad gaminyje yra reglamentuojamas pagal 2012/19/ES Europos direktyvą. Sužinokite apie savo vietinę elektros ir elektronikos gaminių surinkimo sistemą. Laikykitės vietinių taisyklių ir neišmeskite senų gaminių kartu su buitinėmis atliekomis. Tinkamas jūsų senojo gaminio utilizavimas padės išvengti galimos žalos aplinkai ir žmonių sveikatai.

**LV LED GAISMAS TERAPIJAS SEJAS MASKA** – ATRĄS UZSĄKŠANAS CEĻVEDIS KAS IR IEPAKOJUMĀ? Ši ierice ir užladėjama un pārnēsājama, tāpēc to var izmantot bez tiešas pieslēgšanas elektrotīklam. Komplektā ietilpst silikona LED sejas maska, acu aizsargi (1 pāris), vadības pults, uzlādes kabelis (USB A–C) un Velcro siksnas (1 pāris). **VADĪBAS POGAS:** (A) Ieslēgšanas poga – Nospiediet un turiet 2 sekundes, lai ieslēgtu vai izslēgtu. Ierice pēc noklusējuma izslēdzas pēc 10 minūtēm. Vēlreiz nospiežot pogu, taimeris tiek apturēts. (B) Režīmu izvēle – Vienu reizi nospiežot, var mainīt gaismas terapijas režīmus: sarkanu, zaļu, zilu, violetu, ciāna, dzeltenu un baltu. Visi režīmi apvienoti ar tuvā infrasarkanā (NIR) gaismu, lai pastiprinātu efektu. Ekrānā tiek parādīts attiecīgais režīms. Divreiz ātri nospiežot, var izvēlēties kādu no 5 intensitātes līmeņiem. (C) Taimeris – Vienu reizi nospiežot, palielina laiku par 1 minūti, ilgāk turot – ātrāk pievieno minūtes līdz maksimālajām 30 minūtēm. Kad iestatītais laiks beidzas, ierice automātiski izslēdzas. **GAISMAS TERAPIJAS REŽĪMI:** Visi režīmi izmanto 850 nm NIR gaismu, lai uzlabotu iedarbību. Sarkanā gaisma (640nm + 850nm) – Palielina šūnu aktivitāti, stimulē kolagēna ražošanu, uzlabo ādas elastību un mazina grumbas. Zilā gaisma (460nm + 850nm) – Antibakteriāla un pretiekaisuma iedarbība, palīdz mazināt pinnes un ādas bojājumus. Zaļā gaisma (525nm + 850nm) – Aktivizē šūnu enerģiju, līdzina ādas toni, mazina apsārtumu un hiperpigmentāciju. Ciāna gaisma (460nm + 525nm + 850nm) – Nomierina sakairinātu ādu, veicina dziedināšanu un mazina iekaisumu. Dzeltenā gaisma (640nm + 525nm + 850nm) – Veicina audu atjaunošanos, palīdz ārstēt rozāciju, mazina apsārtumu un uzlabo ādas toni. Violetā gaisma (640nm + 460nm + 850nm) – Mērķtiecīga terapija pret pinnēm un rētām. Baltā gaisma (640nm + 525nm + 460nm + 850nm) – Dzīlī iesūcas ādā, paātrina metabolismu un uzlabo barības vielu uzsūkšanos. **ACU AIZSARGU UZSTĀDĪŠANA:** Ievietojiet tos no iekšpusēs. **SĪKSU PIENOSTIPRINĀŠANA:** Ievietojiet un pievelciet ar Velcro aizdāri. **IERĪCES UZLĀDE:** Bridinājums! Šī nav medicīnas ierīce un tā neaizstāj profesionālu ārstēšanu. Iedarbība var atšķirties atkarībā no cilvēka. Nelietojiet ierīci uzlādes laikā. Ja tā pārkarst, izdala dūmus vai neparastu smaku, nekavējoties atvienojiet no lādētāja un sazinieties ar klientu apkalpošanu. Uzlādējiet ierīci, pievienojot USB–C kabeli vadības pultij un USB–A galu – elektrotīkla barošanas avotam. Ja ekrānā mirgo akumulatora ikona, ierice tiek uzlādēta, bet, kad ikona deg nepārtraukti, uzlāde ir pabeigta. Pilna uzlāde aizņem aptuveni 3,5 stundas. **LĪETOŠANAS PAMĀCĪBA:** 1. Pirms lietošanas notīriet un

nosusiniet seju. 2. Pievienojiet LED masku vadības pultij. 3. Nospiediet ieslēgšanas pogu, lai aktivizētu ierici. 4. Izvēlieties vēlamo gaismas terapijas režīmu. 5. Nospiediet taimerī, lai iestatītu sesijas ilgumu (ieteicamais laiks 10–15 minūtes, ne ilgāk par 30 minūtēm). 6. Divreiz ātri nospiediet režīma pogu, lai pielāgotu LED gaismas intensitāti. 7. Ierice ir pārnēsājama un lietošanas laikā nav jāpievieno pie elektrotīkla. 8. Kad sesija beigusies, noslaukiet masku ar mikstu dvieli. Nemērcējiet un neskalojiet zem ūdens! **UZMANĪBAS PASĀKUMI:** 1. Nevērsiet skatienu tieši LED gaismā. 2. Ieteicams turēt acis aizvērtas – ideāls brīdis relaksācijai! 3. Nelokiet, nesaspiediet un nesaspiediet masku. 4. Tīrīšanai izmantojiet mitru drānu, neizmantojiet tekošu ūdeni. Dzīļāki tīrīšanai viegli noslaukiet ar 70% spirta šķīdumu. Elastīgās siksnas var mazgāt ūdenī.

**BRĪDINĀJUMI** Šis produkts izstaro infrasarkanu spektru. Nelietojiet šo ierici ilgāk par 30 minūtēm vienā reizē. Grūtniecēm, bērniem, epilepsijas slimniekiem, personām ar vairogdziedzera slimībām vai tiem, kas lieto vairogdziedzera medikamentus, nevajadzētu izmantot šo produktu. Nelietojiet, ja jums ir fotoalerģija vai lietojat medikamentus, kas var izraisīt fotoalerģiju vai fotosensitivitāti. Izvairieties no lietošanas uz brūcēm vai bojātas ādas. Personām, kas izmanto īpašus medicīniskos implantus, sirdsdarbības monitorus vai kuriem ir īpaši veselības stāvokļi, pirms lietošanas jākonsultējas ar ārstu. Lūdzu, ņemiet vērā, ka nepareiza LED sejas masku lietošana var izraisīt ādas aptumšošanas vai citas problēmas. Personām ar īpašiem medicīniskiem implantātiem, sirdsdarbības monitoriem, īpašām veselības problēmām, sejas brūcēm vai fotosensitivitāti pirms lietošanas jākonsultējas ar ārstu. Nenovietojiet bateriju uguni un nekādā gadījumā to nedemontējiet. Šī ierice atbilst FCC noteikumu 15. daļai. Tās darbība ir pakļauta diviem nosacījumiem: (1) šī ierice nedrīkst radīt kaitīgus traucējumus un (2) šai iericei jāpieņem jebkādi saņemtie traucējumi, tostarp tādi, kas var izraisīt nevēlamu darbību.

**BRĪDINĀJUMI: DROŠA BATERIJU LIETOŠANA** 1. Nemēģiniet izjaukt vai modificēt bateriju. Tas var izraisīt noplūdi, ugunsgrēku vai sprādzienu un anulēt garantiju. Izlietotās baterijas ir pareizi jāizmet un jānodod atbilstoši pārstrādei. Vienmēr ievērojiet ražotāja norādījumus par baterijas kopšanu un uzturēšanu. 2. Neatstājiet ierices bateriju nelietotu ilgstoši. Lai nodrošinātu optimālu baterijas darbību, uzlādējiet to vismaz reizi trijos mēnešos. 3. Lai uzturētu baterijas ilgmūžību, pārļiecinieties, ka ierice tiek uzlādēta saprātīgā laikā pēc lietošanas. Pārāk ilgs izlādes laiks var negatīvi ietekmēt baterijas darbību. 4. Izvairieties no ierices ilgstošas uzglabāšanas ar pilnībā izlādētu bateriju. Pirms ilgstošas uzglabāšanas uzlādējiet bateriju vismaz līdz 50%, lai novērstu neatgriezeniskus bojājumus.

**CE INFORMĀCIJA** „NanoGrid Limited” (Nanoleaf®) paziņo, ka šī ierice atbilst 2014/53/ES direktīvas būtiskajām prasībām un citām attiecīgajām normām. Atbilstības deklarāciju var atrast: <https://nanoleaf.me/eudocs>. **TĪRĪŠANA UN UZTURĒŠANA** – Netīriet ierici ar šķidrumiem vai aerosoliem, kad tā ir pieslēgta pie elektrības. Tīriet ar mikstu sausu drānu un neizmantojiet spēcīgus tīrīšanas līdzekļus.

**GARANTIJAS INFORMĀCIJA** Šim produktam tiek nodrošināta viena gada garantija no iegādes datuma. Bojājumi, kas radušies lietošanas un laika ietekmē, neietilpst pakalpojumu garantijas tvērumā. Šī produkta garantija neattiecas uz bojājumiem, ko izraisījuši jebkādi faktori, izņemot paša produkta defektus.



Jūsu vecā produkta izmešana: Jūsu produkts ir izstrādāts un ražots, izmantojot augstas kvalitātes materiālus un komponentus, kas var tikt pārstrādāti un atkārtoti izmantoti. Ja uz produkta ir attēlots pārsvītrots atkritumu konteiners, tas nozīmē, ka produkts tiek regulēts saskaņā ar Eiropas Direktīvu 2012/19/ES. Noskaidrojiet vietējo elektroierīču un elektronikas atkritumu savākšanas sistēmu. Lūdzu, rīkojieties saskaņā ar vietējiem noteikumiem un neizmetiet vecos produktus kopā ar sadzīves atkritumiem. Pareiza jūsu vecā produkta izmešana palīdzēs novērst iespējamo negatīvo ietekmi uz vidi un cilvēku veselību.

**NL LED LICHTTHERAPIE GEZICHTSMASKER – SNELSTARTGIDS. WAT ZIT ER IN DE DOOS?** Dit apparaat is oplaadbaar en draagbaar en kan worden gebruikt zonder dat het op een stopcontact is aangesloten. Inhoud: siliconen LED-gezichtsmasker, oogbeschermers (1 paar), controller, oplaadkabel (USB A naar C) en klittenbandriem (1 paar). **BEDIENING:** (A) Aan-/uitknop – Houd 2 seconden ingedrukt om in- of uit te schakelen. Het apparaat schakelt standaard na 10 minuten uit. Druk nogmaals om de timer te pauzeren. (B) Modusselectie – Druk eenmaal om te wisselen tussen rood, groen, blauw, paars, cyaan, geel en wit lichttherapie. Elke modus wordt gecombineerd met nabij-infraroodlicht (NIR) voor verbeterde

effecten. Het scherm toont de geselecteerde modus. Druk tweemaal snel om te schakelen tussen 5 intensiteitsniveaus. (C) Timer – Druk eenmaal om 1 minuut toe te voegen, houd ingedrukt voor snel instellen tot max. 30 minuten. Het apparaat schakelt automatisch uit wanneer de tijd is verstreken. **LICHTTHERAPIEMODI:** Alle modi bevatten 850nm NIR-licht voor een diepere werking. Rood licht (640nm + 850nm) – Stimuleert celactiviteit, bevordert collageenvorming, verbetert elasticiteit en vermindert rimpels. Blauw licht (460nm + 850nm) – Antibacterieel en ontstekingsremmend, helpt acne te verminderen en de huid te herstellen. Groen licht (525nm + 850nm) – Verbetert celenergie, egaliseert de huidtint en vermindert roodheid en hyperpigmentatie. Cyaan licht (460nm + 525nm + 850nm) – Kalmeert de huid, bevordert genezing en vermindert ontstekingen. Geel licht (640nm + 525nm + 850nm) – Stimuleert weefselherstel, helpt bij rosacea en vermindert roodheid. Paars licht (640nm + 460nm + 850nm) – Multifrequentietherapie voor acne en littekens. Wit licht (640nm + 525nm + 460nm + 850nm) – Dringt dieper door, versnelt huidmetabolisme en verbetert opname van voedingsstoffen. **INSTALLATIE VAN OOGBESCHERMERS:** Plaats voorzichtig van binnenuit.

**BEVESTIGEN VAN DE BANDEN:** Steek de banden in en zet vast met klittenband. **OPLADEN VAN HET APPARAAT:** Waarschuwing! Dit is geen medisch apparaat en geen vervanging voor professioneel advies. Effecten kunnen per persoon verschillen. Gebruik het apparaat niet tijdens het opladen. Als het oververhit raakt, rook of een vreemde geur afgeeft, koppel het direct los en neem contact op met de klantenservice. Opladen gebeurt via de USB-C-aansluiting van de controller naar een USB-A poort. Als het batterijpictogram knippert, wordt het apparaat opgeladen; als het continu brandt, is het volledig opgeladen. Volledig opladen duurt ca. 3,5 uur. **GEBRUIKSAANWIJZING:** 1. Reinig en droog je gezicht. 2. Sluit het LED-masker aan op de controller. 3. Druk op de aan-/uitknop om het apparaat in te schakelen. 4. Selecteer de gewenste lichttherapiemodus. 5. Druk op de timer om de sessieduur in te stellen (aanbevolen 10–15 min, max. 30 min). 6. Druk tweemaal snel op de modusknop om de intensiteit aan te passen. 7. Dit apparaat is draagbaar en hoeft niet op netstroom te worden aangesloten tijdens gebruik. 8. Na afloop veeg je het masker schoon met een zachte doek. Niet onderdompelen in water! **VOORZORGSMAATREGELEN:** 1. Kijk niet rechtstreeks in de LED-lampjes. 2. Houd je ogen ideaal gesloten voor een ontspannen ervaring. 3. Vouw, druk of buig het masker niet. 4. Maak het masker schoon met een vochtige doek; niet onder stromend water houden. Gebruik voor een grondigere reiniging 70% alcohol. De elastische banden kunnen met water worden gewassen.

**WAARSCHUWINGEN** Dit product bevat een infraroodspectrum. Gebruik dit apparaat niet langer dan 30 minuten per keer. Zwangere vrouwen, kinderen, mensen met epilepsie, schildklierpatiënten of personen die schildkliermedicatie gebruiken, mogen dit product niet gebruiken. Gebruik dit product niet bij fotoallergieën of tijdens het gebruik van geneesmiddelen die fotoallergieën of fotosensitiviteit kunnen veroorzaken. Vermijd gebruik op wonden en beschadigde huid. Personen met speciale medische implantaten, hartslagmonitors of specifieke medische aandoeningen dienen voor gebruik een arts te raadplegen. Let op: onjuist gebruik van LED-gezichtsmaskers kan mogelijk leiden tot huidverkleuring of andere problemen. Personen met medische implantaten, hartslagmonitors, specifieke medische aandoeningen, gezichtsverwondingen of fotosensitiviteit dienen voor gebruik een arts te raadplegen. Gooi de batterij niet in het vuur en demonteer deze onder geen enkele omstandigheid. Dit apparaat voldoet aan Deel 15 van de FCC-regels. De werking is onderworpen aan twee voorwaarden: (1) dit apparaat mag geen schadelijke interferentie veroorzaken, en (2) dit apparaat moet ontvangen interferentie accepteren, inclusief interferentie die een ongewenste werking kan veroorzaken.

**WAARSCHUWINGEN: VEILIG GEBRUIK VAN BATTERIJEN** 1. Probeer de batterij niet te demonteren of te wijzigen. Dit kan lekkage, brand of explosies veroorzaken en zal de garantie ongeldig maken. Gebruikte batterijen dienen op een juiste manier te worden weggegooid en gerecycled. Volg altijd de richtlijnen van de fabrikant voor batterijonderhoud en -verzorging. 2. Laat de batterij van uw apparaat niet gedurende lange tijd ongebruikt. Voor een optimale batterijprestaties dient u de batterij minstens eens per drie maanden op te laden. 3. Om de levensduur van de batterij te behouden, dient het apparaat binnen een redelijke tijd na gebruik te worden opgeladen. Overmatige ontlading kan de prestaties van de batterij negatief beïnvloeden. 4. Vermijd langdurige opslag van het apparaat met een volledig lege batterij. Laad de batterij op tot minstens 50% voordat u het apparaat voor langere tijd opbergt om permanente schade te voorkomen.

**CE INFORMATIE** NanoGrid Limited (Nanoleaf®) verklaart hierbij dat dit apparaat voldoet aan de essentiële vereisten en andere relevante bepalingen van Richtlijn 2014/53/EU. De conformiteitsverklaring is beschikbaar op: <https://nanoleaf.me/eudocs>. **REINIGING EN ONDERHOUD** – Reinig het apparaat niet met vloeistoffen of sprays wanneer het op stroom is aangesloten. Reinig met een zachte, droge doek en gebruik geen agressieve schoonmaakmiddelen.

**GARANTIE-INFORMATIE** Dit product heeft een garantie van één jaar vanaf de aankoopdatum. Schade veroorzaakt door tijd en gebruik valt niet onder de garantie. De garantie van dit product dekt geen defecten die zijn veroorzaakt door andere factoren dan gebreken in het product zelf.



Verwijdering van uw oude product: Uw product is ontworpen en vervaardigd met hoogwaardige materialen en componenten, die gerecycled en hergebruikt kunnen worden. Wanneer het doorgekruiste afvalbak-symbool op een product is aangebracht, betekent dit dat het product onder de Europese Richtlijn 2012/19/EU valt. Informeer naar uw lokale inzamelsysteem voor elektrische en elektronische producten. Volg de plaatselijke voorschriften en gooi uw oude producten niet weg met het gewone huishoudelijke afval. De juiste verwijdering van uw oude product helpt mogelijke negatieve gevolgen voor het milieu en de volksgezondheid te voorkomen.

**NO LED LYSTERAPI ANSIKTSMASKE – HURTIGSTARTSGUIDE. HVA ER I ESKEN?** Denne enheten er oppladbar og bærbar og kan brukes uten å være koblet til en stikkontakt. Innhold: silikon LED-ansiktsmaske, øyebeskyttere (1 par), kontrollør, ladekabel (USB A til C) og borerlåsreim (1 par). **KONTROLLER:** (A) Strømknapp – Hold inne i 2 sekunder for å slå av/på. Enheten slår seg automatisk av etter 10 minutter. Trykk på strømknappen igjen for å pause timeren. (B) Modusvalg – Trykk én gang for å bytte mellom rød, grønn, blå, lilla, cyan, gul og hvit lysterapi. Hver modus kombineres med nær-infrarødt lys (NIR) for å forbedre behandlingen. Skjermen viser valgt modus. Trykk raskt to ganger for å bytte mellom 5 intensitetsnivåer. (C) Timer – Trykk én gang for å legge til 1 minutt, hold inne for raskt å legge til opptil 30 minutter. Enheten slår seg av automatisk når tiden er ute. **LYSTERAPIMODUSER:** Alle moduser kombineres med 850nm NIR-lys for dypere effekt. Rødt lys (640nm + 850nm) – Øker celleaktiviteten, fremmer kollagenproduksjon, forbedrer hudens elastisitet og reduserer rynker. Blått lys (460nm + 850nm) – Antibakterielt og betennelsedempende, hjelper med å redusere akne og reparere huden. Grønt lys (525nm + 850nm) – Stimulerer celleenergi, jevner ut hudtonen og reduserer rødhet og hyperpigmentering. Cyan lys (460nm + 525nm + 850nm) – Lindrer og beroliger stresset hud, fremmer helbredelse og reduserer betennelse. Gult lys (640nm + 525nm + 850nm) – Fremmer vevsheling, hjelper med rosacea og reduserer rødhet. Lilla lys (640nm + 460nm + 850nm) – Multifrekvensbehandling for akne og aknearr. Hvitt lys (640nm + 525nm + 460nm + 850nm) – Trenger dypere inn i huden, akselererer hudens stoffskifte og forbedrer næringsopptak. **INSTALLERING AV ØYEBESKYTTELSE:** Plasser forsiktig fra innsiden. **FESTING AV STROPPER:** Sett inn stroppene og fest med borerlås. **LADING AV ENHETEN:** Advarsel! Dette er ikke et medisinsk apparat og erstatter ikke profesjonell rådgivning. Effektene kan variere fra person til person. Ikke bruk enheten mens den lader. Hvis den blir overopphetet, avgir røyk eller en uvanlig lukt, koble fra laderen umiddelbart og kontakt kundeservice. Lad enheten ved å koble USB-C-kabelen til kontrolløren og USB-A-enden til en strømkilde. Hvis batterikonet blinker, lader enheten; hvis det lyser fast, er den fulladet. Full opplading tar ca. 3,5 timer. **BRUKSANVISNING:** 1. Rengjør og tørk ansiktet. 2. Koble LED-masken til kontrolløren. 3. Trykk på strømknappen for å slå på enheten. 4. Velg ønsket lysterapimodus. 5. Trykk på timerknappen for å justere varigheten (anbefalt 10–15 min, maks 30 min). 6. Trykk raskt to ganger på modusknappen for å justere lysintensiteten. 7. Enheten er bærbar og krever ikke tilkobling til stikkontakt under bruk. 8. Etter bruk, tørk av masken med en myk klut. Ikke senk den i vann! **FORHOLDSREGLER:** 1. Unngå å se direkte på LED-lysene. 2. Lukk øynene under bruk for en avslappende opplevelse. 3. Ikke brett, trykk eller klem masken. 4. Rengjør masken med en fuktig klut, ikke under rennende vann. For grundigere rengjøring, bruk 70% alkohol. De elastiske stroppene kan vaskes med vann.

**ADVARSLER** Dette produktet inneholder et infrarødt spektrum. Ikke bruk denne enheten i mer enn 30 minutter om gangen. Gravide kvinner, barn, personer med epilepsi, skjoldbruskkjertelpasienter eller personer som bruker skjoldbruskkjertelmedisiner, bør ikke bruke dette produktet. Ikke bruk ved fotoallergi eller mens du tar medisiner som kan forårsake fotoallergi eller lysfølsomhet. Unngå bruk på sår og områder med hudskader. Personer med spesielle medisinske implantater, pulsmålere eller spesifikke medisinske tilstander bør rådføre seg med en lege før bruk. Vær oppmerksom på at feil bruk av LED-ansiktsmasker potensielt kan føre til hudmørkning eller andre problemer. Personer med medisinske implantater, pulsmålere, spesifikke medisinske tilstander, ansiktsskader eller lysfølsomhet bør konsultere en lege før bruk. Ikke kast batteriet i ild eller demonter det under noen omstendigheter. Denne enheten overholder del 15 av FCC-reglene. Bruken er underlagt følgende to betingelser: (1) Denne enheten må ikke forårsake skadelig interferens, og (2) Denne enheten må akseptere enhver interferens som mottas, inkludert interferens som kan forårsake uønsket drift.

**ADVARSLER: TRYGG BRUK AV BATTERIER** 1. Ikke forsøk å demontere eller modifisere batteriet. Dette kan føre til lekkasje, brann eller eksplosjon, og vil gjøre garantien ugyldig. Brukte batterier skal kastes og resirkuleres på riktig måte. Følg alltid produsentens retningslinjer for batterivedlikehold. 2. Ikke la enhetens batteri være ubrukt i lengre perioder. For optimal batterityelse bør batteriet lades minst én gang hver tredje måned. 3. For å opprettholde batteriets levetid, sørg for at enheten lades innen rimelig tid etter bruk. Langvarig utladning kan påvirke batteriets ytelese negativt. 4. Unngå langtidslagring av enheten med et utladet batteri. Lad batteriet til minst 50 % før langtidslagring for å unngå permanent skade.

**CE-INFORMASJON** NanoGrid Limited (Nanoleaf®) erklærer herved at denne enheten er i samsvar med de grunnleggende kravene og andre relevante bestemmelser i direktiv 2014/53/EU. Samsvarserklæringen er tilgjengelig på: <https://nanoleaf.me/eudocs>. **RENGJØRING OG VEDLIKEHOLD** - Ikke rengjør enheten med væsker eller spray når den er koblet til strøm. Rengjør med en myk, tørr klut, og bruk ikke sterke rengjøringsmidler.

**GARANTIINFORMASJON** Dette produktet har én års garanti fra kjøpsdatoen. Skader forårsaket av tid og bruk omfattes ikke av garantien. Garantien for dette produktet dekker ikke feil som skyldes andre faktorer enn feil på selve produktet.



Avhending av ditt gamle produkt: Produktet ditt er designet og produsert med materialer og komponenter av høy kvalitet, som kan resirkuleres og gjenbrukes. Når dette utkrysede avfallsdunk-symbolet er festet til et produkt, betyr det at produktet er dekket av europeisk direktiv 2012/19/EU. Undersøk ditt lokale innsamlingssystem for elektriske og elektroniske produkter. Følg dine lokale regler og ikke kast gamle produkter sammen med vanlig husholdningsavfall. Riktig avhending av ditt gamle produkt vil bidra til å forhindre potensielle negative konsekvenser for miljøet og menneskers helse.

**PL MASKA LED DO TERAPII ŚWIATŁEM – INSTRUKCJA SZYBKIEGO URUCHOMIENIA. ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA:** Urządzenie jest przenośne i ładowalne, nie wymaga podłączenia do gniazda podczas użytkowania. **W zestawie:** silikonowa maska LED, osłony na oczy (1 para), kontroler, kabel ładujący (USB A–C), paski na rzepy (1 para). **STEROWANIE:** (A) Przycisk zasilania – Przytrzymaj przez 2 sekundy, aby włączyć/wyłączyć. Domyślnie urządzenie wyłącza się po 10 minutach. Ponowne naciśnięcie przycisku podczas pracy wstrzymuje licznik czasu. (B) Wybór trybu – Naciśnij raz, aby przełączać między terapią światłem czerwonym, zielonym, niebieskim, fioletowym, cyjan, żółtym i białym. Każdy tryb łączy się z bliską podczerwienią (NIR), aby zwiększyć efektywność zabiegu. Ekran wyświetli wybrany tryb. Dwukrotne szybkie naciśnięcie przycisku zmienia poziom intensywności światła (5 stopni). (C) Timer – Naciśnij raz, aby dodać 1 minutę. Przytrzymaj, aby szybko dodać więcej minut (maks. 30). Urządzenie wyłączy się automatycznie po zakończeniu odliczania. **TRYBY TERAPII ŚWIATŁEM:** Każdy tryb zawiera światło NIR (850 nm) dla głębszego działania. Czerwone światło (640 nm + 850 nm) – Pobudza komórki, wspomaga produkcję kolagenu, poprawia elastyczność skóry i redukuje zmarszczki. Niebieskie światło (460 nm + 850 nm) – Działa antybakteryjnie i przeciwzapalnie, pomaga zwalczać trądzik i regenerować skórę. Zielone światło (525 nm + 850 nm) – Stymuluje energię komórkową, wyrównuje koloryt skóry, redukuje zaczerwienienia i przebarwienia. Cyjan (460 nm + 525 nm + 850 nm) – Łagodzi i koi podrażnioną skórę, wspomaga gojenie i redukuje stany zapalne. Żółte światło (640 nm + 525 nm + 850 nm) – Wspiera regenerację tkanek, pomaga w leczeniu trądziku różowatego i poprawia koloryt skóry. Fioletowe światło (640 nm + 460 nm + 850 nm) – Terapia wieloczęstotliwościowa na trądzik i blizny potrądzikowe. Białe światło (640 nm + 525 nm + 460 nm + 850 nm) – Dociera głębiej w skórę, przyspiesza metabolizm i zwiększa wchłanianie składników odżywczych. **INSTALACJA OSŁON NA OCZY:** Delikatnie umieść osłony od wewnątrz. **ZAKŁADANIE PASKÓW:** Przelóż paski i zabezpiecz rzepem. **ŁADOWANIE URZĄDZENIA:** Ostrzeżenie! To nie jest urządzenie medyczne i nie zastępuje porady specjalisty. Efekty mogą się różnić w zależności od osoby. Nie używaj maski podczas ładowania. Jeśli urządzenie stanie się gorące, wydziela dym lub dziwny zapach, natychmiast odłącz ładowarkę i skontaktuj się z obsługą klienta. Aby naładować, podłącz kabel USB–C do kontrolera, a USB–A do źródła zasilania. Migający ikonka baterii oznacza ładowanie; stałe światło oznacza pełne naładowanie (czas ładowania: ok. 3,5 godz.). **JAK UŻYWAĆ:** 1. Oczyść i osusz twarz. 2. Podłącz maskę LED do kontrolera. 3. Naciśnij przycisk zasilania, aby włączyć urządzenie. 4. Wybierz tryb terapii światłem. 5. Ustaw czas sesji (zalecane 10–15 min, maks. 30 min). 6. Dwukrotne szybkie naciśnięcie przycisku trybu reguluje intensywność światła. 7. Urządzenie jest przenośne i działa bez podłączenia do zasilania podczas użytkowania. 8. Po zakończeniu sesji przetrzym maskę miękką ściereczką. Nie zanurzaj jej w wodzie! **ŚRODKI OSTROŻNOŚCI:** 1. Nie patrz bezpośrednio na światło LED. 2. Najlepiej zamknąć oczy – to świetna okazja do relaksu! 3. Nie zginać, nie ścisnąć i nie naciskać na maskę. 4. Zżyć wilgotną ściereczką, nie

myć pod bieżącą wodą. Do dokładniejszego czyszczenia użyj alkoholu 70%. Paski elastyczne można prać w wodzie.

**OSTRZEŻENIA** Ten produkt zawiera widmo podczerwieni. Nie używaj tego urządzenia dłużej niż 30 minut jednorazowo. Kobiety w ciąży, dzieci, osoby z padaczką, pacjenci z chorobami tarczycy lub osoby przyjmujące leki na tarczycę nie powinny używać tego produktu. Nie używaj w przypadku fotoalergii ani podczas przyjmowania leków mogących powodować fotoalergię lub nadwrażliwość na światło. Unikaj stosowania na rany i obszary z uszkodzoną skórą. Osoby posiadające specjalne implanty medyczne, monitory tętna lub cierpiące na szczególne schorzenia powinny skonsultować się z lekarzem przed użyciem. Należy pamiętać, że niewłaściwe użytkowanie masek LED na twarz może prowadzić do ściemnienia skóry lub innych problemów. Osoby posiadające specjalne implanty medyczne, monitory tętna, szczególnie schorzenia, rany na twarzy lub nadwrażliwość na światło powinny skonsultować się z lekarzem przed użyciem. Nie wyrzucaj baterii do ognia ani nie demontuj jej w żadnych okolicznościach. To urządzenie jest zgodne z częścią 15 przepisów FCC. Działanie podlega dwóm następującym warunkom: (1) To urządzenie nie może powodować szkodliwych zakłóceń oraz (2) To urządzenie musi akceptować wszelkie odbierane zakłócenia, w tym zakłócenia mogące powodować niepożądane działanie.

**OSTRZEŻENIA: BEZPIECZNE UŻYTKOWANIE BATERII** 1. Nie próbuj demontować ani modyfikować baterii. Może to prowadzić do wycieku, pożaru lub eksplozji oraz unieważnić gwarancję. Zużyte baterie należy utylizować i poddawać recyklingowi zgodnie z odpowiednimi metodami. Zawsze stosuj się do wytycznych producenta dotyczących pielęgnacji i konserwacji baterii. 2. Nie pozostawiaj baterii urządzenia nieużywanej przez dłuższy czas. Aby zachować optymalne parametry baterii, ładuj ją przynajmniej raz na trzy miesiące. 3. Aby przedłużyć żywotność baterii, upewnij się, że urządzenie jest ładowane w rozsądnym czasie po użyciu. Zbyt długi rozładowanie może negatywnie wpłynąć na wydajność baterii. 4. Unikaj długoterminowego przechowywania urządzenia z rozładowaną baterią. Przed dłuższym przechowywaniem naładuj baterię do co najmniej 50%, aby zapobiec trwałemu uszkodzeniu.

**INFORMACJE CE** NanoGrid Limited (Nanoleaf®) niniejszym oświadcza, że to urządzenie jest zgodne z podstawowymi wymaganiami oraz innymi odpowiednimi przepisami dyrektywy 2014/53/UE. Deklaracja zgodności jest dostępna na stronie: <https://nanoleaf.me/eudocs>. **CZYSZCZENIE I KONSERWACJA** - Nie czyść urządzenia płynami ani sprayami, gdy jest podłączone do zasilania. Czyść miękką, suchą ściereczką i nie używaj silnych środków czyszczących.

**INFORMACJE DOTYCZĄCE GWARANCJI** Ten produkt objęty jest roczną gwarancją od daty zakupu. Uszkodzenia wynikające z upływu czasu i użytkowania nie są objęte gwarancją. Zakres gwarancji tego produktu nie obejmuje usterek spowodowanych czynnikami innymi niż wady samego produktu.



Utylizacja starego produktu: Twój produkt został zaprojektowany i wyprodukowany z materiałów i komponentów wysokiej jakości, które mogą zostać poddane recyklingowi i ponownemu użyciu. Jeśli produkt jest oznaczony symbolem przekreślonego kosza na śmieci, oznacza to, że podlega on dyrektywie europejskiej 2012/19/UE. Sprawdź lokalny system zbiórki odpadów elektrycznych i elektronicznych. Przestrzegaj lokalnych przepisów i nie wyrzucaj starego produktu razem ze zwykłymi odpadami domowymi. Prawidłowa utylizacja starego produktu pomoże zapobiec potencjalnym negatywnym skutkom dla środowiska i zdrowia ludzi.

**RO GHID RAPID PENTRU MASCA FACIALĂ CU TERAPIE LED. CE CONȚINE CUTIA?** Acest dispozitiv este reîncărcabil și portabil, putând fi utilizat fără a fi conectat la priză. Conținutul include: mască facială din silicon cu LED, protecții pentru ochi (1 pereche), controler, cablu de încărcare (USB A-C) și benzi Velcro (1 pereche). **CONTROLARE:** (A) Buton de alimentare – Ține apăsat 2 secunde pentru a porni/opri. Dispozitivul este setat să se oprească automat după 10 minute. Apasă din nou butonul pentru a întrerupe temporizatorul. (B) Selectarea modului – Apasă o dată pentru a comuta între terapiile cu lumină roșie, verde, albastră, violet, cyan, galbenă și albă. Fiecare mod este combinat cu lumină infraroșie apropiată (NIR) pentru a spori efectele tratamentului. Ecranul va indica modul ales. Apasă de două ori rapid pentru a ajusta intensitatea luminii (5 niveluri). (C) Temporizator – Apasă o dată pentru a adăuga 1 minut, Ține apăsat pentru a adăuga mai multe minute până la maximum 30. Dispozitivul se va opri automat când timpul expiră. **MODURI DE TERAPIE CU LUMINĂ:** Toate modulele conțin lumină NIR (850 nm) pentru efecte îmbunătățite. Lumină roșie (640 nm + 850 nm) – Stimulează activitatea celulară, promovează producția de colagen, îmbunătățește

elasticitatea pielii și reduce ridurile. Lumină albastră (460 nm + 850 nm) – Antibacteriană și antiinflamatorie, ajută la reducerea acneei și la regenerarea pielii. Lumină verde (525 nm + 850 nm) – Stimulează energia celulară, uniformizează tonul pielii, reduce roșeața și hiperpigmentarea. Lumină cyan (460 nm + 525 nm + 850 nm) – Calmează pielea stresată, promovează vindecarea și reduce inflamația. Lumină galbenă (640 nm + 525 nm + 850 nm) – Favorizează vindecarea țesuturilor, ajută la tratarea rozaceei și îmbunătățește tonul pielii. Lumină violet (640 nm + 460 nm + 850 nm) – Tratament multifrecvență pentru acnee și cicatrici post-acneice. Lumină albă (640 nm + 525 nm + 460 nm + 850 nm) – Pătrunde adânc în piele, accelerează metabolismul și îmbunătățește absorbția nutrienților. **INSTALAREA PROTECȚIILOR PENTRU OCHI:** Așază-le delicat în interior. **FIXAREA BENZILOR:** Introdu benzile și fixează-le cu Velcro. **ÎNCĂRCAREA DISPOZITIVULUI:** Avertisment! Acesta nu este un dispozitiv medical și nu înlocuiește sfatul unui specialist. Efectele pot varia de la persoană la persoană. Nu utiliza masca în timpul încărcării. Dacă dispozitivul devine fierbinte, emite fum sau un miros neobișnuit, deconectează imediat încărcătorul și contactează serviciul clienți. Pentru încărcare, conectează cablul USB-C la controler și capătul USB-A la o sursă de alimentare. Dacă pictograma bateriei clipește, dispozitivul se încarcă. O încărcare completă durează aproximativ 3,5 ore. **CUM SE UTILIZEAZĂ:** 1. Curăță și usucă fața. 2. Conectează masca la controler. 3. Apasă butonul de alimentare pentru a porni dispozitivul. 4. Selectează modul de terapie dorit. 5. Setează durata sesiunii (recomandat 10-15 min, max. 30 min). 6. Apasă de două ori rapid butonul de mod pentru a regla intensitatea luminii. 7. Dispozitivul este portabil și nu necesită alimentare în timpul utilizării. 8. După finalizarea sesiunii, șterge masca cu o lavetă moale. Nu o scufunda în apă! **PRECAUȚII:** 1. Evită contactul direct al ochilor cu lumina LED. 2. Este recomandat să ții ochii închiși pentru relaxare. 3. Nu îndoi, nu strânge și nu presa masca. 4. Curăță cu o lavetă umedă, fără a o spăla sub jet de apă. Pentru o curățare profundă, folosește alcool 70%. Benzile elastice pot fi spălate cu apă.

**AVERTISMENTE** Acest produs conține un spectru de infraroșu. Nu utilizați acest dispozitiv pentru mai mult de 30 de minute la un moment dat. Femeile însărcinate, copiii, persoanele cu epilepsie, pacienții cu afecțiuni tiroidiene sau cei care urmează un tratament pentru tiroidă nu ar trebui să utilizeze acest produs. Nu utilizați în caz de fotoalergii sau în timpul administrării de medicamente care pot provoca fotoalergii sau fotosensibilitate. Evitați rănile și zonele cu traumatisme ale pielii. Persoanele care utilizează implanturi medicale speciale, monitoare de ritm cardiac sau care au afecțiuni medicale speciale trebuie să consulte un medic înainte de utilizare. Vă rugăm să rețineți că utilizarea necorespunzătoare a mâșlor LED pentru față poate duce la întunecarea pielii sau la alte probleme. Persoanele care utilizează implanturi medicale speciale, monitoare de ritm cardiac, care au afecțiuni medicale speciale, răni faciale sau fotosensibilitate trebuie să consulte un medic înainte de utilizare. Nu aruncați bateria în foc și nu o demontați în nicio circumstanță. Acest dispozitiv respectă partea 15 a Regulamentului FCC. Funcționarea este supusă următoarelor două condiții: (1) Acest dispozitiv nu poate provoca interferențe dăunătoare și (2) Acest dispozitiv trebuie să accepte orice interferență primită, inclusiv interferențe care pot provoca funcționare nedorită.

**AVERTISMENTE: UTILIZAREA ÎN SIGURANȚĂ A BATERIILOR** 1. Nu încercați să demontați sau să modificați bateria. Acest lucru poate duce la scurgeri, incendii sau explozii și va anula garanția. Trebuie respectate metodele corecte de eliminare și reciclare a bateriilor uzate. Consultați întotdeauna ghidul producătorului pentru îngrijirea și întreținerea bateriei. 2. Nu lăsați bateria dispozitivului neutilizată pentru perioade lungi de timp. Pentru a menține sănătatea optimă a bateriei, încărcați-o cel puțin o dată la trei luni. 3. Pentru a menține durata de viață a bateriei, asigurați-vă că dispozitivul este încărcat într-un interval rezonabil de timp după utilizare. O descărcare excesivă poate afecta negativ performanța bateriei. 4. Evitați depozitarea pe termen lung a dispozitivului cu bateria complet descărcată. Încărcați bateria la cel puțin 50% înainte de depozitarea pentru perioade lungi pentru a preveni deteriorarea permanentă.

**INFORMAȚII CE** NanoGrid Limited (Nanoleaf®) declară prin prezenta că acest dispozitiv respectă cerințele esențiale și alte prevederi relevante ale Directivei 2014/53/UE. Declarația de conformitate este disponibilă la: <https://nanoleaf.me/eudocs>. **CURĂȚARE ȘI ÎNȚEȚINERĂ** - Nu curățați dispozitivul cu lichide sau spray-uri când este conectat la curent. Curățați cu o cârpă moale și uscată și nu folosiți agenți de curățare agresivi.

**INFORMAȚII DESPRE GARANȚIE** Acest produs are o garanție de un an de la data achiziției. Deteriorările cauzate de uzură și timp nu sunt acoperite de garanția serviciului. Garanția acestui produs nu include defectele cauzate de factori externi în afara defectelor produsului în sine.



Eliminarea produsului vechi: Produsul dumneavoastră este proiectat și fabricat din materiale și componente de înaltă calitate, care pot fi reciclate și reutilizate. Când acest simbol al coșului de gunoi tăiat este atașat unui produs, înseamnă că acesta este acoperit de Directiva Europeană 2012/19/UE. Informați-vă despre sistemul local de colectare a produselor electrice și electronice. Respectați regulile locale și nu aruncați produsele vechi împreună cu deșeurile menajere obișnuite. Eliminarea corectă a produsului vechi va contribui la prevenirea potențialelor efecte negative asupra mediului și sănătății umane.

**SK RÝCHLY ŠTARTOVACÍ SPRIEVODCA PRE LED MASKU NA TVÁR. ČO JE V BALENÍ?** Toto zariadenie je nabíjateľné a prenosné, takže ho možno používať bez pripojenia k zásuvke.

**Obsah balenia:** silikónová LED maska na tvár, ochranné krytky na oči (1 pár), ovládač, nabíjací kábel (USB A-C) a suchý zips (1 pár). **OVĽADANIE:** (A) Tlačidlo napájania – Podržte 2 sekundy na zapnutie/vypnutie. Zariadenie sa automaticky vypne po 10 minútach. Krátkym stlačením tlačidla počas prevádzky pozastavíte časovač. (B) Výber režimu – Jedným stlačením prepínate medzi terapiami červeným, zeleným, modrým, fialovým, tyrkysovým, žltým a bielym svetlom. Každý režim je kombinovaný s blízkym infračerveným svetlom (NIR) pre lepšie účinky. Na displeji sa zobrazí zvolený režim. Dvojším rýchlym stlačením nastavíte intenzitu svetla (5 úrovní). (C) Časovač – Jedným stlačením pridáte 1 minútu, dlhým podržaním pridáte viac minút (max. 30). Po uplynutí času sa zariadenie automaticky vypne. **REŽIMY SVETELNEJ TERAPIE:** Všetky režimy obsahujú NIR svetlo (850 nm) na zlepšenie účinkov. Červené svetlo (640 nm + 850 nm) – Podporuje bunkovú aktivitu, tvorbu kolagénu, zlepšuje elasticitu pokožky a redukuje vrásky. Modré svetlo (460 nm + 850 nm) – Antibakteriálne a protizápalové účinky na akné a hojenie pokožky. Zelené svetlo (525 nm + 850 nm) – Stimuluje energiu buniek, zjednocuje tón pleti, redukuje začervenanie a hyperpigmentáciu. Tyrkysové svetlo (460 nm + 525 nm + 850 nm) – Upokojuje podráždenú pokožku, podporuje hojenie a redukuje zápal. Žlté svetlo (640 nm + 525 nm + 850 nm) – Pomáha liečiť rosaceu, redukuje začervenanie a zlepšuje tón pleti. Fialové svetlo (640 nm + 460 nm + 850 nm) – Kombinovaná terapia na liečbu akné a jaziev. Biele svetlo (640 nm + 525 nm + 460 nm + 850 nm) – Preniká hlbšie do pokožky, urýchľuje metabolizmus a zlepšuje absorpciu živín. **INŠTALÁCIA OCHRANNÝCH KRYTIEK NA OČI:** Jemne ich vložte zvnútra. **PRIPEVNENIE POPRUHOV:** Vložte popruhy a upevnite suchým zipsom. **NABÍJANIE ZARIADENIA:** Upozornenie! Toto nie je lekárske zariadenie a nenahrádza odborné poradenstvo. Účinky sa môžu líšiť podľa jednotlivcov. Masku nepoužívajte počas nabíjania. Ak sa zariadenie prehrieva, vydáva dym alebo nezvyčajný zápach, okamžite odpojte nabíjačku a kontaktujte zákaznický servis. Nabíjajte pripojením USB-C kábla k ovládaču a USB-A koncu do zdroja napájania. Ak ikona batérie bliká, zariadenie sa nabíja. Plné nabitie trvá približne 3,5 hodiny. **AKO POUŽÍVAŤ:** 1. Vyčistite a osušte tvár. 2. Pripojte masku k ovládaču. 3. Stlačte tlačidlo napájania na zapnutie. 4. Zvoľte svetelný režim. 5. Nastavte dĺžku terapie (odporúčané 10-15 min, max. 30 min). 6. Dvojším rýchlym stlačením tlačidla režimu nastavíte intenzitu svetla. 7. Počas používania nie je potrebné pripojenie k sieti. 8. Po dokončení terapie masku utrite jemnou utierkou. Nenamáčajte ju do vody! **BEZPEČNOSTNÉ OPATRENIA:** 1. Nehľadte priamo do LED svetiel. 2. Počas používania majte zatvorené oči – ideálny čas na relax! 3. Masku neskladajte, nestláčajte ani na ňu netlačte. 4. Na čistenie použite navlhčenú utierku, nie priamu vodu. Na dôkladnejšie čistenie použite 70% alkohol. Elastické popruhy je možné prať vo vode.

**UPOZORNENIA** Tento produkt obsahuje infračervené spektrum. Nepoužívajte toto zariadenie dlhšie ako 30 minút naraz. Tehotné ženy, deti, osoby s epilepsiou, pacienti s ochoreniami štítnej žľazy alebo osoby užívajúce lieky na štítnu žľazu by nemali tento produkt používať. Nepoužívajte v prípade fotoalergie alebo pri užívaní liekov, ktoré môžu spôsobiť fotoalergie alebo fotosenzitivitu. Vyhnite sa ranám a oblastiam s poranenou pokožkou. Osoby, ktoré používajú špeciálne zdravotnícke implantáty, monitory srdcového tepu alebo majú špeciálne zdravotné problémy, by sa pred použitím mali poradiť s lekárom. Upozorňujeme, že nesprávne používanie LED masiek na tvár môže potenciálne viesť k stmavnutiu pokožky alebo iným problémom. Osoby, ktoré používajú špeciálne zdravotnícke implantáty, monitory srdcového tepu, ktoré majú špeciálne zdravotné problémy, poranenia tváre alebo fotosenzitivitu, by sa pred použitím mali poradiť s lekárom. Batériu nevyhadzujte do ohňa a nerozoberajte ju za žiadnych okolností. Toto zariadenie je v súlade s časťou 15 predpisov FCC. Prevádzka podlieha nasledujúcim dvom podmienkam: (1) Toto zariadenie nesmie spôsobovať škodlivé rušenie a (2) Toto zariadenie musí akceptovať akékoľvek prijaté rušenie, vrátane rušenia, ktoré môže spôsobiť nežiaducu prevádzku.

**UPOZORNENIA: BEZPEČNÉ POUŽÍVANIE BATÉRIÍ** 1. Nepokúšajte sa batériu rozoberať ani upravovať. Môže to viesť k úniku, požiaru alebo explózií a zároveň to anuluje záruku. Pri likvidácii a recyklácii použitých batérií je potrebné dodržiavať správne postupy. Vždy sa riadte pokynmi výrobcu na údržbu batérie. 2. Nenechávajte batériu zariadenia dlhodobo

nepoužívanú. Pre optimálne zdravie batérie ju nabíte aspoň raz za tri mesiace. 3. Aby sa predĺžila životnosť batérie, uistite sa, že zariadenie je nabité v primeranom čase po použití. Príliš dlhé vybitie môže negatívne ovplyvniť výkon batérie. 4. Vyhnite sa dlhodobému skladovaniu zariadenia s úplne vybitou batériou. Pred dlhodobým skladovaním nabíte batériu aspoň na 50 %, aby ste predišli trvalému poškodeniu.

**INFORMÁCIE CE** NanoGrid Limited (Nanoleaf®) týmto vyhlasuje, že toto zariadenie je v súlade so základnými požiadavkami a ďalšími príslušnými ustanoveniami smernice 2014/53/EÚ. Vyhlásenie o zhode je dostupné na: <https://nanoleaf.me/eudocs>. **ČISTENIE A ÚDRŽBA** – Nečistite zariadenie kvapalinami alebo sprejmi, keď je pripojené k elektrine. Čistite mäkkou suchou handričkou a nepoužívajte agresívne čistiace prostriedky.

**INFORMÁCIE O ZÁRUKU** Tento produkt má jednoročnú záruku odo dňa nákupu. Poškodenia spôsobené časom a používaním nie sú zahrnuté do záruky. Záruka na tento produkt sa nevzťahuje na poruchy spôsobené inými faktormi ako chybami samotného produktu.



Likvidácia vášho starého produktu: Váš produkt je navrhnutý a vyrobený z vysoko kvalitných materiálov a komponentov, ktoré je možné recyklovať a znovu použiť. Ak je na produkte uvedený symbol prečiarknutého odpadkového koša, znamená to, že produkt spadá pod európsku smernicu 2012/19/EÚ. Informujte sa o miestnom systéme zberu elektrických a elektronických výrobkov. Riadte sa miestnymi predpismi a nevyhadzujte staré produkty s bežným komunálnym odpadom. Správna likvidácia vášho starého produktu pomôže predísť potenciálnym negatívnym dôsledkom na životné prostredie a ľudské zdravie.

**SV SNABBSTARTSGUIDE FÖR LED-LJUSTERAPI ANSIKTSMASK. VAD FINNS I FÖRPACKNINGEN?** Denna enhet är uppladdningsbar och portabel och kan användas utan att vara ansluten till ett eluttag. **Innehåll:** silikon LED-ansiktsmask, ögonskydd (1 par), kontrollenhet, laddningskabel (USB A till C) och kardborreband (1 par). **KONTROLLER:** (A) Strömknapp – Håll in i 2 sekunder för att slå på/av. Enheten är förinställd att stängas av efter 10 minuter. Tryck en gång till för att pausa timern. (B) Lägesval – Tryck en gång för att växla mellan rött, grönt, blått, lila, cyan, gult och vitt ljus. Varje ljusläge kombineras med nära infrarött ljus (NIR) för bättre effekt. Skärmen visar valt ljusläge. Tryck snabbt två gånger för att justera ljusstyrkan i 5 nivåer. (C) Timer – Tryck en gång för att lägga till 1 minut. Håll inne för att snabbt öka tiden upp till 30 minuter. Enheten stängs av automatiskt när tiden är slut. **LJUSTERAPILÄGEN:** Alla lägen innehåller NIR-ljus (850 nm) för att förbättra effekten. Rött ljus (640 nm + 850 nm) – Stimulerar cellaktivitet, kollagenproduktion, förbättrar hudens elasticitet och minskar rynkor. Blått ljus (460 nm + 850 nm) – Antibakteriellt och antiinflammatoriskt, hjälper mot akne och hudirritation. Grönt ljus (525 nm + 850 nm) – Stimulerar cellenergi, jämnar ut hudtonen och reducerar rodnad och hyperpigmentering. Cyanljus (460 nm + 525 nm + 850 nm) – Lugnar irriterad hud, påskyndar läkning och minskar inflammation. Gult ljus (640 nm + 525 nm + 850 nm) – Främjar vävnadsläkning, behandlar rosacea, reducerar rodnad och förbättrar hudtonen. Lila ljus (640 nm + 460 nm + 850 nm) – Målbehandlar akne och akneärr. Vitt ljus (640 nm + 525 nm + 460 nm + 850 nm) – Tränger djupare in i huden, påskyndar ämnesomsättningen och förbättrar näringsupptaget.

**INSTALLATION AV ÖGONSKYDD:** Sätt försiktigt in ögonskydden inifrån. **FÄSTNING AV BANDEN:** För in banden och justera med kardborre. **LADDNING AV ENHETEN:** Varning! Detta är inte en medicinsk enhet och ersätter inte professionell rådgivning. Effekterna kan variera. Använd inte masken under laddning. Om enheten blir för varm, ryker eller luktar konstigt, koppla genast ur laddaren och kontakta kundservice. Ladda genom att ansluta USB-C-kabeln till kontrollenheten och USB-A-änden till en strömkälla. Om batteriikonen blinkar laddas enheten. Full laddning tar ca 3,5 timmar. **ANVÄNDNING:** 1. Rengör och torka ansiktet. 2. Anslut masken till kontrollenheten. 3. Tryck på strömknappen för att starta. 4. Välj ljusläge. 5. Justera sessionens längd (rekommenderat 10–15 min, max 30 min). 6. Tryck snabbt två gånger på lägesknappen för att justera ljusstyrkan. 7. Masken är sladdlös vid användning. 8. Efter avslutad behandling, torka av masken med en mjuk trasa. Doppa eller skölj den inte i vatten! **FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER:** 1. Undvik att titta direkt på LED-ljuset. 2. Håll ögonen stängda under användning – perfekt för avkoppling! 3. Vik, pressa eller tryck inte på masken. 4. Torka av med en fuktig trasa, inte rinnande vatten. För djupare rengöring, använd 70 % alkohol. Elastiska band kan tvättas i vatten.

**VARNINGAR** Denna produkt innehåller ett infrarött spektrum. Använd inte denna enhet i mer än 30 minuter åt gången. Gravida kvinnor, barn, personer med epilepsi,

sköldkörtelpatienter eller personer som tar medicin för sköldkörteln bör inte använda denna produkt. Använd inte vid fotoallergier eller vid intag av läkemedel som kan orsaka fotoallergier eller ljuskänslighet. Undvik sår och områden med hudskador. Personer med medicinska implantat, pulsmätare eller andra medicinska tillstånd bör rådgöra med en läkare före användning. Observera att felaktig användning av LED-ansiktmasker kan leda till mörkare hud eller andra problem. Personer med medicinska implantat, pulsmätare, speciella medicinska tillstånd, ansiktsskador eller ljuskänslighet bör rådgöra med en läkare före användning. Kassera inte batteriet i eld och demontera det inte under några omständigheter. Denna enhet överensstämmer med del 15 av FCC:s regler. Drift är föremål för följande två villkor: (1) Denna enhet får inte orsaka skadlig störning och (2) Denna enhet måste acceptera all mottagen störning, inklusive störning som kan orsaka oönskad drift.

**VARNINGAR: SÄKER ANVÄNDNING AV BATTERIER** 1. Försök inte demontera eller modifiera batteriet. Detta kan leda till läckage, brand eller explosion och upphäver garantin. Korrekt kassering och återvinning av använda batterier ska följas. Följ alltid tillverkarens riktlinjer för batterivård och underhåll. 2. Lämna inte enhetens batteri oanvänt under längre perioder. För optimal batterihälsa, ladda batteriet minst en gång var tredje månad. 3. För att bevara batteriets livslängd, se till att enheten laddas inom rimlig tid efter användning. En alltför lång urladdningstid kan påverka batteriets prestanda negativt. 4. Undvik långtidsförvaring av enheten med ett urladdat batteri. Ladda batteriet till minst 50 % innan långtidsförvaring för att förhindra permanent skada.

**CE-INFORMATION** NanoGrid Limited (Nanoleaf®) förklarar härmed att denna enhet överensstämmer med de grundläggande kraven och andra relevanta bestämmelser i direktiv 2014/53/EU. Försäkran om överensstämmelse finns tillgänglig på: <https://nanoleaf.me/eudocs>. **RENGÖRING OCH UNDERHÅLL** - Rengör inte enheten med vätskor eller sprejer när den är ansluten till ström. Rengör med en mjuk, torr trasa och använd inte starka rengöringsmedel.

**GARANTIINFORMATION** Denna produkt har ett års garanti från inköpsdatumet. Skador orsakade av tid och användning omfattas inte av garantin. Garantin för denna produkt täcker inte fel som orsakas av andra faktorer än själva produktens defekter.



Kassering av din gamla produkt: Din produkt är designad och tillverkad med högkvalitativa material och komponenter som kan återvinnas och återanvändas. När denna symbol med en överkryssad soptunna är fäst vid en produkt innebär det att produkten omfattas av Europaparlamentets och rådets direktiv 2012/19/EU. Ta reda på vilka insamlingssystem som gäller för elektriska och elektroniska produkter i din kommun. Följ lokala bestämmelser och släng inte gamla produkter tillsammans med vanligt hushållsavfall. Korrekt kassering av din gamla produkt bidrar till att förebygga potentiella negativa konsekvenser för miljön och människors hälsa.

**TC LED 光療面罩快速入門指南. 盒內內容物:** 本裝置可充電且便攜, 無需連接電源即可使用。包含矽膠 LED 面罩、眼部保護墊 (1 對)、控制器、充電線 (USB A 至 C) 和魔鬼氈固定帶 (1 對)。**控制按鍵:** (A) 電源按鈕 - 長按 2 秒開/關機, 預設 10 分鐘後自動關機, 開機狀態下再次按下可暫停計時。(B) 模式選擇 - 按一下可切換紅、綠、藍、紫、青、黃、白光療模式, 每種模式皆結合近紅外線 (NIR) 增強效果, 螢幕顯示對應燈色。快速按兩下可調整 5 級光強度, 螢幕會顯示對應強度。(C) 計時器 - 按一下增加 1 分鐘, 長按可快速增加至最多 30 分鐘, 時間結束後自動關機。**光療模式:** 所有模式均含 850nm 近紅外線 (NIR), 可加強治療效果。紅光 (640nm + 850nm) - 促進細胞活性和膠原蛋白生成, 改善肌膚彈性並減少皺紋。藍光 (460nm + 850nm) - 具抗菌與消炎作用, 有助於減少痘瘡並修復肌膚。綠光 (525nm + 850nm) - 刺激細胞能量, 均勻膚色, 減少紅腫與色素沉澱。青光 (460nm + 525nm + 850nm) - 舒緩敏感肌膚, 促進癒合並減少炎症。黃光 (640nm + 525nm + 850nm) - 促進組織修復, 改善玫瑰座瘡、減少紅腫並提亮膚色。紫光 (640nm + 460nm + 850nm) - 多頻光療模式, 可針對痘瘡與痘疤。白光 (640nm + 525nm + 460nm + 850nm) - 深入肌膚, 加速新陳代謝並提升養分吸收。**眼部保護墊安裝:** 從內側輕輕放入眼部保護墊, 確保正確安裝。**固定帶安裝:** 插入固定帶並用魔鬼氈調整鬆緊。**充電方式 警告:** 本產品非醫療設備, 不能作為專業治療或醫療建議的替代品, 實際效果因人而異。充電時請勿使用, 如發熱、冒煙或異味, 請立即拔除電源並聯繫客服。**充電方式:** 將 USB-C 端插入控制器, USB-A 端插入電源插座, 控制器螢幕上電池圖示閃爍表示正在充電, 充滿電時圖示恆亮, 完全充電約需 3.5 小時, 最大充電規格為 5V 1A。**使用方法:** 1. 使用前請清潔並擦乾臉部。2. 連接 LED 面罩與控制器。3. 按電源鍵 開機。4. 按 模式鍵 選擇光療模式。5. 按 計時鍵 設定療程時間 (建議 10-15 分鐘, 最多 30 分鐘)。6. 快速按 模式鍵 兩次調整 LED 強度。7. 本產品可無線使用, 無需連接電源。8. 完成療程後, 用軟布擦拭面罩, 勿浸泡或用水沖洗。**注意事項:** 1. 避免直視 LED 燈光。2. 建

關閉眼使用，享受放鬆時刻。3. 勿摺疊、擠壓或重壓面罩。4. 清潔時請用濕布擦拭，不可浸泡水中，可用 70% 酒精擦拭消毒，彈性固定帶可水洗。警告 本產品包含紅外線光譜，每次使用時間不得超過 30 分鐘。孕婦、兒童、癩病患者、甲狀腺疾病患者或正在服用甲狀腺藥物者請勿使用。對光敏感、對光過敏或正在服用可能引起光過敏或光敏性的藥物者請勿使用，避免於傷口或皮膚受損處使用。配戴特殊醫療植入物、心率監測器或患有特殊醫療狀況者應諮詢醫生後再使用。請注意，不當使用 LED 面罩可能導致皮膚變黑或其他問題。請勿將電池投入火中或拆解，以免導致火災或爆炸。設備符合 FCC 第 15 部分 規範，運行需符合以下條件：(1) 不得產生有害干擾；(2) 必須接受所有外部干擾。本產品電池需妥善使用與回收，請勿拆解或長時間不充電，建議至少每三個月充電一次，並避免長時間存放於電量耗盡狀態，應至少充電至 50% 以防止損壞。清潔與保養：設備連接電源時請勿使用液體或噴霧清潔，僅能用柔軟乾布擦拭，避免使用刺激性清潔劑。保固資訊：本產品自購買日起享有一年保固，但因時間和使用造成的損壞不在服務保固範圍內，且產品缺陷以外因素導致的故障亦不包含在保固範圍內。

**SC LED 光疗面罩快速入門指南 包裝內容：**本設備可充電且便攜，無需連接電源即可使用。包含：硅膠 LED 面罩、眼罩保護片（1 對）、控制器、充電線（USB A 轉 C）、魔术貼綁帶（1 對）。**控制按鈕：**（A）電源按鈕：長按 2 秒開/關，默認 10 分鐘後自動關閉，再次按下可暫停計時。（B）模式選擇：按一下可切換紅光、綠光、藍光、紫光、青光、黃光和白光，每種模式均結合近紅外光（NIR）以增強效果，屏幕會顯示相應模式。快速按兩下可在 5 級亮度間切換。（C）計時：按一下增加 1 分鐘，長按可快速增加至最多 30 分鐘，時間結束後設備會自動關閉。光療模式：所有光模式均結合 850nm 近紅外光（NIR）以增強療效。紅光（640nm + 850nm）促進細胞活性，增加膠原蛋白，改善彈性並減少皺紋。藍光（460nm + 850nm）具有抗菌和抗炎作用，有助於減少痘瘡並修復肌綠。綠光（525nm + 850nm）刺激細胞能量，均勻肤色，減少紅斑和色素沉著。青光（460nm + 525nm + 850nm）緩解壓力，促進癒合並改善炎症。黃光（640nm + 525nm + 850nm）促進組織修復，幫助治療酒渣鼻，減少紅血丝，改善肤质。紫光（640nm + 460nm + 850nm）多頻治療，針對痘瘡及痘印。白光（640nm + 525nm + 460nm + 850nm）深層穿透，加速皮膚代謝並提高養分吸收。**安裝眼罩：**將眼罩從內側輕柔放入。綁帶安裝：插入綁帶并用魔术貼固定。充電：本設備非醫療器械，不可用於專業治療或替代醫生建議。使用因人而異。充電時請勿使用，如設備過熱、冒煙或發出異常氣味，請立即斷開電源並联系客服。使用 USB-C 線連接控制器，USB-A 端插入電源，屏幕上電池圖標閃爍表示正在充電，充滿後圖標常亮。充電需約 3.5 小時（5V 1A）。**使用方案：**1. 清潔并擦干臉部。2. 連接 LED 面罩與控制器。3. 按電源鍵開啟設備。4. 按模式鍵選擇光療模式。5. 按計時鍵調整時長（建議 10-15 分鐘，最多 30 分鐘）。6. 快速按兩下模式鍵調整亮度。7. 設備充電後可無線使用。8. 計時結束後，用軟布擦拭面罩，勿浸水或用水沖洗。**注意事項：**1. 避免直視 LED 光源。2. 建議閉眼使用，享受放鬆時光。3. 請勿折疊、擠壓或按壓面罩。4. 清潔時請勿浸泡，僅用濕布擦拭，深度清潔可使用 70% 酒精擦拭，綁帶可用清水輕柔清洗。**警告** 本產品包含紅外線光譜，每次使用時間不得超過 30 分鐘。孕婦、兒童、癩病患者、甲狀腺疾病患者或正在服用甲狀腺藥物者請勿使用。對光敏感、對光過敏或正在服用可能引起光過敏或光敏性的藥物者請勿使用，避免於傷口或皮膚受損處使用。佩戴特殊醫療植入物、心率監測器或患有特殊醫療狀況者應諮詢醫生後再使用。請注意，不當使用 LED 面罩可能導致皮膚變黑或其他問題。請勿將電池投入火中或拆解，以免導致火災或爆炸。本設備符合 FCC 第 15 部分 規範，運行需符合以下條件：(1) 不得產生有害干擾；(2) 必須接受所有外部干擾。**電池安全使用：**1. 請勿拆解或修改電池，以免導致泄漏、火災或爆炸，並使保修失效。請遵循正確的電池回收與處理方式，並參考製造商的電池保養與維護指南。2. 長時間不使用時，請至少每三個月充電一次，以保持電池健康狀態。3. 為維持電池壽命，請在便用後適時充電，過度放電可能會影響電池性能。4. 避免長期存放於電量耗盡狀態。長期存放前應至少充電至 50% 以防止永久損壞。**清潔與保養：**設備連接電源時請勿使用液體或噴霧清洗，僅能用柔軟干布擦拭，避免使用刺激性清潔劑。保修信息：本產品自購買日起享有一年保修，但因時間和使用造成的損壞不在服務保修範圍內，且產品缺陷以外因素導致的故障亦不包含在保修範圍內。

**KR LED 광테라피 마스크 빠른 시작 가이드 구성품:** 본 제품은 충전식이며 휴대가 가능하여 전원에 연결하지 않고도 사용할 수 있습니다. 구성품: 실리온 LED 마스크, 아이 소켓 보호대(1쌍), 컨트롤러, 충전 케이블(USB A to C), 벨크로 스트랩(1쌍). 컨트롤 버튼: (A) 전원 버튼 - 2초간 길게 눌러 전원 켜기/끄기. 기본적으로 10분 후 자동 종료되며, 커진 상태에서 한 번 더 누르면 타이머가 일시 정지됩니다. (B) 모드 선택 - 한 번 누르면 적색, 녹색, 청색, 보라색, 청록색, 황색, 백색의 광테라피 모드 변경 가능. 각 모드는 근적외선(NIR)과 함께 작용하여 효과를 증대시킵니다. 화면에 해당 모드가 표시됩니다. 두 번 빠르게 누르면 5단계 강도 조절이 가능하며, 화면에 강도 단계가 표시됩니다. (C) 타이머 - 한 번 누르면 타이머에 1분 추가, 길게 누르면 최대 30분까지 빠르게 증가합니다. 타이머 시간이 끝나면 자동으로 전원이 꺼집니다. 광테라피 모드: 모든 광 모드는 850nm 근적외선(NIR)과 결합하여 치료 효과를 증대시킵니다. 적색광 (640nm + 850nm) - 세포 활동을 촉진하고 콜라겐 생성을 증가시켜 피부 탄력을 개선하고 주름을 줄여줍니다. 청색광 (460nm + 850nm) - 항균 및 항염 효과로 여드름 완화 및 피부 재생을 돕습니다. 녹색광 (525nm + 850nm) - 세포 에너지를 활성화하여 피부 톤을 균일하게 하고 홍조 및 색소 침착을 줄여줍니다. 청록색광 (460nm + 525nm + 850nm) - 민감한 피부를 진정시키고 염증을 치료하여 피부 치유를 촉진합니다. 황색광 (640nm + 525nm + 850nm) - 조직 치유를 촉진하여 주사(ruacea) 치료, 홍조 감소 및 피부 톤 개선을 돕습니다. 보라색광 (640nm + 460nm + 850nm) - 다중 주파수 치료로 여드름 및 여드름 흉터를 개선합니다. 백색광 (640nm + 525nm + 460nm + 850nm) - 피부 깊숙이 침투하여 피부 신진대사 속도를 촉진하고 염증을 강화합니다. 아이 소켓 보호대 설치 방법: 보호대를 안쪽에서 부드럽게 삽입하고, 스트랩 부착 방법: 스트랩을 삽입한 후 벨크로로 조여 고정하세요. 충전 방법: 본 제품은 의료 기기가 아니며 전문 치료나 의료 조연을 대체할 수 없습니다. 사용 효과는 개인차가 있을 수 있습니다. 충전 중에는 제품을 사용하지 마세요. 충전 중 과열, 연기 발생, 이상한 냄새가 나면 즉시 충전을 분리하고 고객 서비스 센터에 문의하세요. 컨트롤러에 USB-C 케이블을 연결하고 USB-A 단자를 전원 포트에 꽂으세요. 컨트롤러 화면의 배터리 아이콘이 깜빡이면 충전 중이며, 완전히 충전되면 아이콘이 계속 표시됩니다. 전원 방전 상태에서 충전 완료까지 약 3.5시간이 소요됩니다(5V 1A). 사용 방법: 1. 사용 전 얼굴을 깨끗이 세안하고 물기를 제거하세요. 2. LED 마스크를

コントロールに 연결하세요. 3. 전원 버튼을 눌러 전원을 켜세요. 4. 모드 버튼을 눌러 원하는 광테라피 모드를 선택하세요. 5. 타이머 버튼을 눌러 원하는 사용 시간을 설정하세요(권장 사용 시간 10~15분, 최대 30 분). 6. 모드 버튼을 두 번 빠르게 눌러 LED 광 강도를 조절하세요. 7. 제품은 충전식으로, 전원에 연결하지 않고도 사용할 수 있습니다. 8. 타이머가 종료되면 부드러운 천으로 마스크를 닦아주세요. 마스크를 물에 담그거나 흐르는 물에 세척하지 마세요. 주의 사항: 1. LED 빛을 직접 바라보지 마세요. 2. 사용 중 눈은 감는 것이 좋습니다. 편안한 휴식 시간이 될 수 있습니다. 3. 마스크를 접거나 강하게 누르지 마세요. 4. 마스크 세척 시 물에 담그지 말고, 부드러운 천으로 닦아주세요. 깊은 세척이 필요할 경우 70% 알코올을 부드럽게 닦아 사용하세요. 스트랩은 깨끗한 물로 가볍게 세척할 수 있습니다. 경고 이 제품은 적외선 스펙트럼을 포함하고 있으며, 한 번에 30분 이상 사용하지 마십시오. 임신부, 어린이, 간질 환자, 감작성 질환자 또는 감작성 약물을 복용 중인 사람은 사용을 금합니다. 광알레르기가 있거나 광알레르기 또는 광과민성을 유발할 수 있는 약물을 복용 중인 경우 사용하지 마십시오. 상처가 있거나 피부 손상이 있는 부위에는 사용하지 마십시오. 의약품 이식 장치, 심박수 모니터를 사용하는 경우 또는 특정 의료 상태가 있는 경우 사용 전에 의사와 상담하십시오. LED 얼굴 마스크를 부적절하게 사용할 경우 피부가 어두워지거나 기타 문제가 발생할 수 있습니다. 배터리를 물에 버리거나 임의로 분해하지 마십시오. 이 장치는 FCC 규정 15조를 준수하며, 유해한 간섭을 유발하지 않아야 하고, 예상치 못한 작동은 유발할 수 있는 간섭을 포함하여 모든 간섭을 허용해야 합니다. 배터리는 분해하거나 개조하지 말고, 올바른 폐기 및 재활용 방법을 따라야 하며, 장기간 방치하지 않도록 최소 3개월에 한 번은 충전하십시오. 배터리 수명을 유지하려면 사용 후 적절한 시간 내에 충전하고, 방전된 상태로 장기간 보관하지 말고 최소 50% 이상 충전하여 보관하십시오. 제품을 전원이 연결된 상태에서 액체나 스프레이로 청소하지 말고, 부드러운 마른 천으로 닦아주며 강한 세정제를 사용하지 마십시오. 이 제품은 구매일로부터 1년간 보증되며, 사용에 따른 자연적인 마모 및 손상, 제품 자체의 결함이 아닌 기타 요인으로 인한 고장은 보증 대상에 포함되지 않습니다.

**JP LED 라이트 세라피 페이스 마스크 퀵스타트 가이드** 본 제품은 충전식으로 휴대 가능하며, 콘센트에 연결 없이 사용할 수 있습니다. 세트에는 실리콘 LED 페이스 마스크, 아이소케이블 프로텍터 (1組), 컨트롤러, USB A to C 충전 케이블, 벨크로 스트랩 (1組)이 포함됩니다. **操作方法** (A) 전원 버튼을 2초간長押し하여 온/오프. 디폴트로 10분後に自動오프. 온의 상태에서 전원 버튼을 누르면 타이머를一時停止. (B) 모드 선택 버튼을 누르면赤、綠、青、紫、シアン、黄、白의 광療法 모드를切り替え. 각 모드에는近赤外線 (NIR)가組み合わされ、治療効果を向上. 画面に選択したモードが表示. 버튼을2回押すと5段階の光強度を調整可能. (C) 타이머 버튼을 누르면1分追加. 長押しで最大30分まで設定可能. 設定時間終了後、自動で오프. 光療法 모드 各モードは850nm의近赤外線を含み、効果を向上. 赤(640nm+850nm):細胞活動を促進しコラーゲン生成をサポート. 肌の弾力を向上しシワを軽減. 青(460nm+850nm):抗菌・抗炎症効果でニキビの発生を抑制し、肌を修復. 綠(525nm+850nm):細胞エネルギーを刺激し、肌のトーンを均一に整え. 赤みや色素沈着を軽減. シアン(460nm+525nm+850nm):ストレスを受けた肌を鎮静し、炎症を治療. 黄(640nm+525nm+850nm):組織修復を促し、赤みを抑え、肌のトーンを改善. 紫(640nm+460nm+850nm):ニキビやニキビ跡に対応する多波長トリートメント. 白(640nm+525nm+460nm+850nm):深部まで浸透し、肌の代謝を促進し栄養吸収を向上. **アイソケーブルの装着方法** 内側から優しくセットし、正しい向きで取り付け. **ストラップの装着方法** ストラップを差し込み、ベルクロで固定. **充電方法** 本製品は医療機器ではなく、専門的な治療や医療アドバイスの代わりにはなりません. 効果は個人差があります. 充電中の使用は避け、異常な発熱や煙、異臭が発生した場合は充電を中止し、カスタマーサービスへ連絡. **USB-Cケーブルをコントローラーに接続し、USB-A側を電源ポートに接続.** コントローラー画面のバッテリーアイコンが点滅すると充電中、満充電になると点灯. 0%からのフル充電には約3.5時間. 充電中のマスク使用は禁止. 充電仕様: 5V 1A 最大. **使用方法** ①使用前に顔を清潔にして乾燥させる ②LEDマスクをコントローラーに接続 ③電源 버튼을 누르면 온 ④모드 버튼을 누르면、希望の光療法 모드を選択 ⑤타이머 버튼을 누르면時間を設定 (推奨10~15分、最大30分) ⑥모드 버튼을2回押して光の強さを調整 ⑦本製品は充電式でポータブルなため、使用中に電源接続不要 ⑧타이머終了後、柔らかな布で拭き取り、水洗いや水没は避ける. **注意事項** ①LED光を直接見ない ②使用中は目を閉じるのが理想的 (リラクゼーションに最適) ③マスクを折り曲げたり強く押し付けない ④清掃時は水に浸さず、濡らせた布で拭き、深く清掃する際は70%アルコールで優しく拭く. ストラップは水洗い可能. **警告** 本製品は赤外線スペクトルを含んでおり、一度に30分以上使用しないでください. 妊娠中の方、子供、てんかん患者、甲状腺疾患のある方や甲状腺治療薬を服用している方は使用を避けてください. 光アレルギーがある方、または光アレルギーや光過敏症を引き起こす可能性のある薬を服用している方は使用しないでください. 傷や皮膚の損傷がある部分には使用しないでください. 医療用インプラントや心拍モニターを使用している方、または特定の医療状態をお持ちの方は、使用前に医師に相談してください. LEDフェイスマスクを誤った方法で使用する、肌の暗化やその他の問題が発生する可能性があります. バッテリーを火に投げ込んだり、分解したりしないでください. 本製品はFCC規則第15条に準拠しており、(1)有害な干渉を引き起こさないこと、および(2)望まない動作を引き起こす可能性のある干渉を含め、受信するすべての干渉を受け入れることが条件となります. バッテリーの安全な使用について バッテリーを分解・改造しないでください. これにより液漏れ、発火、爆発の原因となり、保証が無効になります. 使用済みバッテリーは適切な廃棄およびリサイクル方法に従って処理してください. バッテリーを長期間未使用のままにしないでください. 最適なバッテリー状態を維持するため、少なくとも3か月に1回は充電してください. 使用後は適切なタイミングで充電し、過放電のまま長期間放置しないようにしてください. バッテリーを完全に充電した状態で長期間保管すると、永久的な損傷を引き起こす可能性があります. 保管時は50%以上の充電を維持してください. お手入れとメンテナンス 電源接続中に液体やスプレーで清掃しないでください. 柔らかな乾いた布で拭き、強力な洗剤の使用は避けてください. 保証情報 本製品には購入日から1年間の保証があります. 経年劣化や使用による損傷は保証の対象外であり、本製品自体の欠陥以外の要因による故障も保証範囲には含まれません.



## Still Need Help?

[go.nanoleaf.me/face-mask-manual](https://go.nanoleaf.me/face-mask-manual)

### Nanoleaf Canada

#200-106 Front Street East  
Toronto, ON  
M5A 1E1, Canada

### Nanoleaf Europe SAS

11 Rue de Lourmel  
75015 Paris  
France  
[Hello@nanoleaf.me](mailto>Hello@nanoleaf.me)

### Nanoleaf Europe SAS

Ruby House, 8 Ruby Place  
Aberdeen AB10 1ZP  
Great Britain

### Nanoleaf Hong Kong

NanoGrid Limited  
#1301-483A Castle Peak Road,  
Kowloon, Hong Kong

### Model:

2021081201, E49

**Rating Input:** 5V 1A

**Battery Storage:** 2500mAh



(EN) Paper collection (FR) Collecte de papier  
(DE) Papiersammlung (PT) Coleção de papel  
(ES) Recogida de papel (IT) Raccolta carta



Points de collecte sur [www.quefairedemesdechets.fr](http://www.quefairedemesdechets.fr)  
Privilégiez la réparation ou le don de votre appareil !



@nanoleaf



@thenanoleaf

nanoleaf.me