


iHealth Clear

Rychlý průvodce nastavením






Před prvním použitím plně dobijte baterii přístroje.


1

Položte levou paži na stůl.



2


Navlečte manžetu na levou paži tak, aby vývod hadičky z manžety byl uprostřed paže a směřoval k prostřednímu prstu.



Zarovnejte manžetu tak, aby vývod hadičky směřoval k vašemu prostředníčku.


3

Spodní okraj manžety umístěte 1-2 cm nad loketní ohyb. Mezi manžetou a paží ponechte prostor přibližně na jeden prst.



4

Vložte plastovou koncovku hadičky do tlakoměru a přístroj se automaticky spustí.



Ujistěte se, že je koncovka hadičky správně připojena k tlakoměru.

5

Jakmile se přístroj poprvé spustí, zvolte požadovaný jazyk.



6

Pro spuštění měření znovu stiskněte tlačítko uživatele jedna, nebo dvě.

Stiskněte kterékoliv tlačítko pro zastavení měření a vypnutí přístroje.



Během měření ucítíte, jak se manžeta obepíná kolem vaší paže. Zůstaňte v klidu a nehýbejte s paží, dokud se měření nedokončí.

Nastavení bezdrátové sítě

1

Otevřete Apple Store nebo Google Play a stáhněte si aplikaci "iHealth MyVitals". Vytvořte si uživatelský účet a přihlaste se.




MyVitals

2

Stiskněte a držte tlačítko uživatele 2 po dobu 10 sekund, dokud displej nezobrazí možnost volby jazyka.

Stiskněte pro změnu jazyka

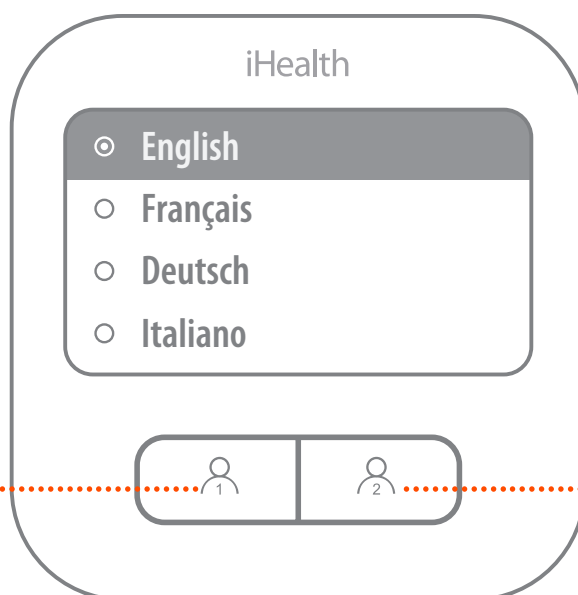

Stiskněte pro potvrzení jazyka

3

Poté displej zobrazí nastavení pro bezdrátovou síť. Spustěte aplikaci iHealth MyVitals, otevřete nastavení nového zařízení a vyberte Clear (BPM1). Postupujte podle instrukcí a dokončete nastavení bezdrátové sítě.



Nastavení kompletní!
Váš tlakoměr automaticky odesílá
naměřené údaje do aplikace iHealth
MyVitals